Инструмент линейный сшивающий режущий

Одноразовый

⚠ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ОПИСАНИЕ

Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый накладывает два двойных ряда титановых скобок в шахматном порядке,

одновременно рассекая и разделяя ткань между ними. Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый представлен тремя модификациями в зависимости от длины (60 мм, 80 мм и 100 мм).

Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый состоит из скобок двух размеров: 3,8 мм и 4,8 мм в зависимости от разной толщины ткани. Подробные данные относительно размеров скобок и длин картриджа сведены в таблицу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый можно перезагружать до 7 раз за в общей сложности 8 запусков на инструмент.

ПОКАЗАНИЯ

Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый применяется в абдоминальной, гинекологической, педиатрической и грудной хирургии для резекции, рассечения тканей и анастомоза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Запрещается использовать инструменты на тканях печени и селезенки, которые могут разрушиться при закрытии инструмента.
2. Не используйте инструмент в случае, если ткань нельзя легко сжать до указанного минимального значения или до величины, ниже требуемой. Требуемые значения указаны в таблице «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый должен выстреливать не более 8 раз. Более частое применение может вызвать неправильное формирование скоб и привести к протеканию или разрушению скрепочного шва.
2. При использовании инструмента более одного раза за одну процедуру убедитесь, что

на наковальне за одну процедуру убедитесь, что на наковальне отсутствуют кусочки ткани, кровь и другие посторонние предметы.

3. Перед закрытием инструмента убедитесь, что сальник или брыжейка не попали между площадками для картриджа и наковальни.


4. Убедитесь, что выбранный размер скобы соответствует толщине ткани. Слишком толстая или тонкая ткань может вызвать неправильное формирование скобы.

5. При использовании армирующего материала убедитесь, что его толщина включена в общую толщину ткани с тем, чтобы выбрать скобу соответствующего размера.

6. Не вращайте кнопку запуска во время выстрела. Такое вращение может вызвать повреждение и возможную поломку инструмента.

7. Всегда проверяйте скрепочный шов на гемостаз. При необходимости, при незначительном кровотечении можно наложить обычный хирургический шов или применить гальванокаустику.

8. Инструмент линейный сшивающий режущий одноразовый поставляется СТЕРИЛЬНЫМ и предназначен исключительно для ОДНОКРАТНОГО использования. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ!

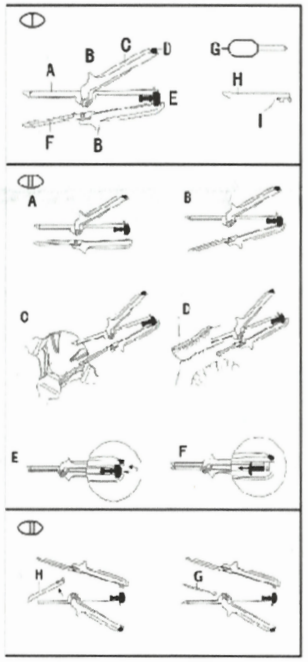

I. СХЕМАТИЧЕСКОЕ

A) ПЛОЩАДКА ДЛЯ КАРТРИДЖА
B) ПЛЕЧО
C) ЗАЖИМНАЯ СТОПОРНАЯ РУКОЯТКА
D) СПУСКОВАЯ КНОПКА
E) КНОПКА ВЫСТРЕЛА
F) ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАКОВАЛЬНИ
G) ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ
H) КАРТРИДЖ
I) ЛЕЗВИЕ НОЖА В СБОРКЕ

1. Откройте инструмент, нажав на спусковую кнопку, расположенную в задней части инструмента, и потянув зажимную рукоятку площадки картриджа.

2. Убедитесь, что картридж плотно зафиксирован, он будет подниматься и опускаться, находясь в окончательном положении. Удалите транспортировочный клиновый зажим из

картриджа, подняв его за выступы.

3. Поместите ткань между площадкой картриджа и наковальни, или, при необходимости формирования анастомозы бок в бок, поместите площадку картриджа в один просвет, а площадку наковальни в другой просвет.

4. Соберите две половины инструмента так, чтобы они были параллельны или соединены сзади. Закройте инструмент, перемещая зажимную рукоятку к корпусу инструмента до щелчка.

5. Поместите большой палец за кнопку выстрела и два пальца на плечо инструмента. Активизируйте инструмент, нажав на кнопку выстрела вперед до упора.

Внимание: Не вращайте кнопку запуска во время выстрела. Такое вращение может вызвать повреждение и возможную поломку инструмента.

6. После выстрела верните кнопку в исходное положение.

7. Откройте инструмент, нажав на спусковую кнопку и потянув зажимную рукоятку. Удалите инструмент с ткани.

Внимание: Всегда проверяйте скрепочный шов на гемостаз. Если необходимо, при незначительном кровотечении можно наложить обычный хирургический шов или применить гальванокаустику.

Внимание: Если инструмент находится в открытом состоянии, сработает блокировка. Для обеспечения безопасности блокировка предотвращает сжатие инструмента с уже использованным картриджем.

III. ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕЗАРЯДКЕ

1. Удалите использованный картридж, разведя половинки инструмента. Удерживая площадку картриджа, поместите пальцы в выступы на ближайшем конце картриджа и потяните.

2. Поместите новый картридж в инструмент, удерживая картридж за выступы на ближнем конце и вводя его в площадку для картриджа под углом 30-45 градусов по отношению к дальнему концу до полной фиксации. После окончательной установки картриджа удалите транспортировочный клиновый зажим.

Внимание: Убедитесь, что выбранный размер скобы соответствует толщине ткани. Слишком толстая или тонкая ткань может вызвать неправильное формирование скобы.


Внимание: При использовании инструмента более одного раза за одну процедуру убедитесь,

что на наковальне отсутствуют кусочки ткани, кровь и другие посторонние предметы.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КОД	КОД СМЕННОГО КАРТРИДЖА	ДЛИНА СКРЕПОЧНОГО ШВА	СКОБКА ВЫСОТА	ЗАКРЫТАЯ ВЫСОТА	СЖАТИЕ ТКАНИ ТРЕБОВАНИЕ	ЦВЕТ
SLC60B	LCR60B	60 мм	3,8 мм	1,5 мм	1,5 мм	СИНИЙ
SLC60G	LCR60G	60 мм	4,8 мм	2,0 мм	2,0 мм	ЗЕЛЕНЫЙ
SLC80B	LCR80B	80 мм	3,8 мм	1,5 мм	1,5 мм	СИНИЙ
SLC80G	LCR80G	80 мм	4,8 мм	2,0 мм	2,0 мм	ЗЕЛЕНЫЙ
SLC100B	LCR100B	100 мм	3,8 мм	1,5 мм	1,5 мм	СИНИЙ
SLC100G	LCR100G	100 мм	4,8мм	2,0 мм	2,0 мм	ЗЕЛЕНЫЙ

ХРАНИТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.



НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 130 ºF (54 ºC).

CE 0197

Компания Виктор Медикал Инструментс, Лтд. (Victor Medical Instruments Co., Ltd.)
Адрес: 21, Хуафен Роуд, р-н Уцзинь, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, 213018, Китай
Тел: +86-519-88411367
Факс: +86-519-88411358