


RÜSCH UROLOGY

Для применения практически в любой ситуации





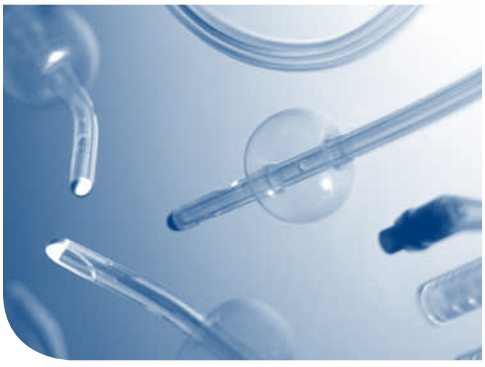

Teleflex

УРОЛОГИЯ

Цветовая кодировка, наконечники и продолжительность установки 02

1 УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

1.1 Стандартные двухходовые катетеры 03
1.2 Катетеры для послеоперационного дренирования, двух- и трехходовые 06
1.3 Катетеры Фолея для детей 12
1.4 Катетеры специального назначения 14
1.5 Дополнительные принадлежности 16

2 БЕЗБАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

2.1 Катетеры, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ) 17
2.2 Катетеры, изготовленные из резины 19

3 НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

3.1 Набор для катетеризации мочевого пузыря — описание 20
3.2 Набор для катетеризации мочевого пузыря — продолжительность стояния 21

4 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ

4.1 Наборы для применения у взрослых и детей 22
4.2 Обзор наборов 24
4.3 Набор для выполнения экстренной пункции 25

5 МОЧЕПРИЕМНИКИ

5.1 Присоединенные 26
5.2 Закрытые системы для отведения мочи 27
5.3 Дополнительные принадлежности 30

6 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

6.1 Мочеточниковые катетеры SUPERGLIDE для стандартной установки 32
6.2 Мочеточниковые катетеры для стандартной установки 33
6.3 Мочеточниковые катетеры специального назначения 35
6.4 Окклюзионные катетеры 36
6.5 Струны-проводники 37
6.6 Дополнительные принадлежности 38

7 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ

7.1 Мочеточниковые стенты SUPERGLIDE 39
7.2 Мочеточниковые стенты 42
7.3 Мочеточниковые стенты для детей 44
7.4 Мочеточниковые стенты специального назначения 46
7.5 Набор мочеточникового стента ECO 47

8 НЕФРОСТОМИЯ

8.1 Наборы для пункции 48
8.2 Сменные наборы 49
8.3 MIPP-набор 50
8.4 Канюли для пункции 51
8.5 Струны-проводники 52
8.6 Дилататоры/ренальные кожухи/катетеры для чрескожной нефростомии 53

9 ЭКСТРАКТОРЫ КАМНЕЙ

9.1 Корзинки из проволоки плоского сечения 57
9.2 Корзинки из проволоки круглого сечения 58

10 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ УРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10.1 Катетеры для цистометрографии/комбинированной уретроцистометрографии 59
10.2 Ректальные баллонные катетеры 61

11 ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11.1 Бужи 62
11.2 Гидравлические уретральные дилататоры 64
11.3 Гидравлические мочеточниковые дилататоры 65
11.4 Механические мочеточниковые дилататоры 66

Указатель каталожных номеров 67
Приложение 69

RÜSCH



ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО

Серия RÜSCH от компании Teleflex предлагает хорошо зарекомендовавшее себя качество для применения практически во всех отраслях урологии — от трансуретральной катетеризации мочевого пузыря до уродинамических исследований.
Наша более чем 100-летняя работа и, вероятно, уникальный опыт дают нам возможность сделать каждое изделие максимально простым, удобным и безопасным как для пациентов, так и для врачей и других медицинских работников.
Однако мы не останавливаемся на достигнутом.
Мы постоянно находимся в поиске совершенства, непрерывно проводя научно-исследовательскую работу и применяя новые технологии, что приводит к созданию изделий медицинского назначения, качество которых является эталоном по всему миру.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧТИ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

В нашем широком ряду изделий для применения в урологии вы найдете высококачественные инструменты для применения практически в любой ситуации — как для стандартного применения, так и специального назначения – и это позволяет оказать оптимальную помощь пациентам.

ДЕТЯМ — ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Дети острее переживают хирургические вмешательства по сравнению с взрослыми. Хорошо зная об этом, мы производим изделия, уделяя внимание каждой детали, особенно наконечникам и дренажным отверстиям, чтобы убедиться в их абсолютной гладкости и закругленности.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ

Широкий спектр используемых материалов позволяет нам выбрать изделие, подходящее для применения практически в любой ситуации, что не только отвечает потребностям пациентов, но и экономически выгодно. Кроме того, высокий стандарт качества всех материалов Rüsch гарантирует максимальную безопасность.

ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Мы предлагаем на выбор широкий ассортимент размеров – особенно для уретральных катетеров, катетеров для надлобковой цистостомии, мочеточниковых стентов и мочеточниковых катетеров.


КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Мы предлагаем широкий ассортимент катетеров Фолея для уретральной катетеризации мочевого пузыря, изготовленных из разных материалов, с разными наконечниками, всех необходимых размеров, для кратковременной и долговременной установки, а также для использования в послеоперационном периоде. Не имеет значения, какой катетер Фолея Вы выберете, неизменными останутся простота и безопасность в обращении, высокий комфорт для пациента и экономичность.

Независимо от назначения – стандартного или специального, все катетеры серии RÜSCH компании Teleflex имеют наконечники, максимально облегчающие введение. Широкий диапозон – соответствующее изделие для любого случая, как для кратковременного, так и для долговременного применения.

НАКОНЕЧНИКИ	
цилиндрический	
Тимана	
Кувелера	
Дюфура	
Мерсье	
свисток	


МАТЕРИАЛЫ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕДЕЛЯХ					
	1	2	3	4	5	6
Силикон • биосовместимый, биостабильный, неаллергенный • поверхность, угнетающая отложение солей • эффективное отведение мочи; также идеален для долговременного использования • безопасность и простота установки • высокий комфорт для пациента						
Силиконовый эластомер, покрытый латексом • износостойкое покрытие изнутри и снаружи • гибкий латексный стержень • гладкая поверхность снаружи и изнутри • уменьшение тенденции к отложению солей • может быть установлен на более длительное время, чем катетер из Rüsch Gold Latex (латекса)						
Silkolatex (латекс) • чрезвычайно экономичный						
поливинилхлорид (ПВХ) • действенное отведение мочи • безопасность и простота установки • адаптируется к анатомическим условиям • эффективная аспирация сгустков крови и резецированных тканей • очень хорош для применения в послеоперационном периоде						

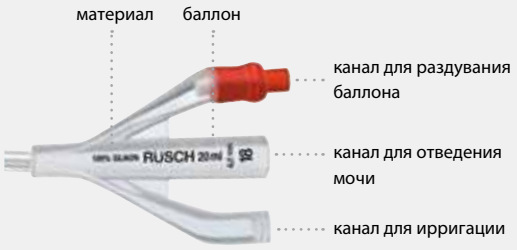

Наружный диаметр катетера, например, 18 по шкале Шарьера/Френч = 6 мм

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ			
	1 дренажное отверстие		2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке
	2 дренажных отверстия, расположенных напротив		3 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке
	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии		по всему наконечнику (TYP)

Цветовая кодировка:

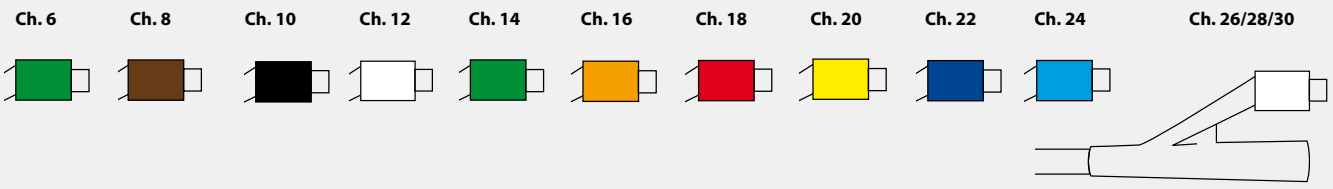

1 УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

1.1 СТАНДАРТНЫЙ ДВУХХОДОВЫЙ КАТЕТЕР

PROFILCATH GLYCERINE

Силиконовый

с продольными бороздками



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	171505	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	5



КАТЕТЕР ФОЛЕЯ PROFILCATH AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный, с продольными бороздками для оттока уретрального секрета, с заполненным шприцем для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

AQUAFLATE GLYCERINE

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	178000	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	5
	178001	для ЖЕНЩИН, цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 23 см	5
	178305	Тимана				
		Ch. 12-24	10 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный, с заполненным шприцем для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	170605	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	10
	171305	Тимана				
		Ch. 12-24	10 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

1

** Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SILASIL,
изготовленный из латекса, с внутренним и наружным износоустойчивым покрытием из эластомера силикона, синий

- внутреннее износоустойчивое покрытие из эластомера силикона
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

SILASIL

Латекс

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	186005*	цилиндрический				
		Ch. 12-30	5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	186505*	Тимана				
		Ch. 12-24	5-15 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- для кратковременного отведения мочи
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH GOLD

Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	180605*	цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 мл 5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	180105*	для ЖЕНЩИН, цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-22	5-10 мл 5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 25 см	10
	181305*	Тимана				
		Ch. 12/14 Ch. 16-26	5-10 мл 5-15 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный из поливинилхлорида, прозрачный

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- красная контрастная полоса вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения

SOFTSIMPLASTIC

Поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	660610*	цилиндрический				
		Ch. 12-26	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	661610*	Тимана				
		Ch. 14-22	10 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

WIRUTHAN®

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	331305*	Тимана				
		Ch. 6/8 Ch. 10/12	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH,
изготовленный из полиуретана, прозрачный

- с баллоном Rüsch Gold из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

РЕЗИНА ROBUSTA

Резина



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	201661*	Тимана				
		Ch. 10 Ch. 12-24	3-5 мл 5-15 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ,
изготовленный из резины Robusta, красный

- с латексным покрытием
- с баллоном Rüsch Gold из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ

Силикон – идеальный для долговременного использования
Катетеры Фолея Rüsch Brillant, изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Спонтанные реакции на данный материал неизвестны.
Благодаря хорошей переносимости силикон является идеальным материалом для изготовления катетеров, даже предназначенных для долговременного использования. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи.
Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера.
Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.

Латекс*
Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде.

SiLaSil – латекс*, покрытый эластомером силикона
Структура силиконового покрытия дала имя катетерам: SiLaSil = слой силикона – латексный средний слой – слой силикона. Стержень из латекса очень гибкий. Износостойкое гладкое покрытие из силикона уменьшает возможность отложения солей и увеличивает сроки стояния катетера. Таким образом, катетеры SiLaSil сочетают положительные характеристики латекса и силикона, предлагая высокий комфорт для пациентов с хорошей экономической эффективностью.

Поливинилхлорид (ПВХ) – идеален для применения в послеоперационном периоде
Высококачественный термочувствительный материал особенно подходит для катетеров, предназначенных для ирригации и отведения мочи в послеоперационном периоде. Пластик при введении остается довольно жестким, что облегчает катетеризацию.
Под действием тепла тела ПВХ приобретает гибкость, поэтому катетер может оптимально приспособиться к анатомии пациента.
Это обеспечивает комфорт для пациента.
Очень большой внутренний диаметр по сравнению с наружным обеспечивает высокую способность к отведению мочи.
Ровные и плотные стенки катетера позволяют безопасно проводить ирригацию и препятствуют обтурации во время аспирации сгустков крови и резецированных тканей.

** Латексные катетеры нельзя применять у лиц, с возможностью развития аллергической реакции на компоненты этих изделий.*

1.2 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ДВУХ- И ТРЕХХОДОВЫЕ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона,
прозрачный

Катетеры для послеоперационного отведения мочи, двухходовые

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	170630	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	10
	172530	Кувелера				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный
из поливинилхлорида (ПВХ),
прозрачный




Катетеры для послеоперационного отведения мочи, двухходовые

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- красная контрастная полоса вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения

SOFTSIMPLASTIC

Поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	660630*	цилиндрический				
		Ch. 14-28	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	661630*	Тимана				
		Ch. 14-22	30 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10
	662530* 662575*	Кувелера				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	662630* 662675*	Дюфура				
		Ch. 18-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	662430*	Мерсье				
		Ch. 14-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	663630*	свисток				
		Ch. 14-28	30 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10


ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

** Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

RÜSCH GOLD

Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	180630*	цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	30 мл 30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	181330*	Тимана				
		Ch. 14-24	30-50 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

Катетеры для послеоперационного отведения мочи, двухходовые

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH GOLD, АРМИРОВАННЫЙ

Армированный латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	183530*	цилиндрический				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10

Спираль в стенке катетера обеспечивает максимальную гибкость, широкий просвет на всем протяжении и высокую растяжимость.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, армированный, желтый


Катетеры для послеоперационного отведения мочи, двухходовые

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

РЕЗИНА ROBUSTA

Резина



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	201665*	Тимана				
		Ch. 12-24	30-50 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10
	202201*	Делинотта, наконечник Мерсье				
		Ch. 18-24	50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	5
	202600*	Дюфура				
		Ch. 16-24	50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ,
изготовленный из резины Robusta, красный

Катетеры для послеоперационного отведения мочи, двухходовые

- с латексным покрытием
- с баллоном Rüsch Gold из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный

Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
		цилиндрический, жесткий наконечник				
	173830	Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173810	Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 мл 100 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
		Кувелера				
	173930	Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173910	Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 мл 100 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	174030	Дюфура				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	174130	Мерсье				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ PROFILCATH RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный, с продольными бороздками для отведения уретрального секрета

Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

PROFILCATH

Силиконовый с продольными бороздками



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173430	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173230	Кувелера				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173330	с просветом для инстилляций для лечения заболеваний уретры, с отверстием для инстилляций, расположенным ниже баллона, цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

ТРЕХХОДОВЫЙ КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ИЗ СИЛИКОНА

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173800	цилиндрический				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	173900	Кувелера				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	174000	Дюфура				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	174100	Мерсье				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ,
изготовленный из силикона, прозрачный

Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- расположенный близко к стержню баллон большого объема
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

1

** Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ), прозрачный






Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- красная контрастная полоса вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения

SOFTSIMPLASTIC

Поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	664330*	цилиндрический				
		Ch. 18-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прим. 42 см	10
	664130* 664176*	Кувелера				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	664530* 664575*	Дюфура				
		Ch. 18-22 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	664230* 664275*	Мерсье				
		Ch. 20-24	30 мл	2 дренажных отверстия спереди и 1 — позади от баллона 2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
		Ch. 18-24	75 мл			
	663230*	свисток				
		Ch. 18-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прим. 42 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый



Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH GOLD

Латекс






	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	183405*	цилиндрический				
		Ch. 18-26	5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	183430*	цилиндрический				
		Ch. 18-26	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	183230*	свисток				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

RÜSCH GOLD, АРМИРОВАННЫЙ

Армированный
латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	183830*	цилиндрический				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	183960*	Кувелера				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10
	183930*	свисток				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	184110*	Катетер ТУР, цилиндрический, наконечник Мерсье				
		Ch. 18-24	50-100 мл	дренажные отверстия по всему наконечнику	прибл. 40 см	10

Спираль в стенке катетера обеспечивает максимальную гибкость, широкий просвет на всем протяжении и высокую растяжимость.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, армированный, желтый

Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

РЕЗИНА ROBUSTA

Резина



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
		Дюфура				
	204500* 204502*	Ch. 16-26 Ch. 18-24	50 мл 50-100 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	5
		Фромюллера, наконечник Мерсье				
	204401* 204410*	Ch. 18-26 Ch. 20-26	50 мл 50-100 мл	3 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	5

Наконечник: Из соображений безопасности у всех наших баллонов емкостью более 100 мл (100-миллилитровые баллоны) несколько увеличена окружность.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ,
изготовленный из резины Robusta, красный

Катетер для послеоперационного отведения мочи, трехходовый

- с латексным покрытием
- с баллоном Rüsch Gold из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

1.3 КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный, с заполненным шприцем для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (1,5, 3 или 5 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

AQUAFLATE GLYCERINE

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	178003	цилиндрический, с мандреном, жесткий наконечник				
		Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 мл 3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 31 см	5
	178004	Тимана, с мандреном				
		Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 31 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	170003	цилиндрический, с мандреном, жесткий наконечник				
		Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 мл 3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 31 см	5
	170004	Тимана, с мандреном				
		Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 31 см	5


КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- для кратковременного отведения мочи
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH GOLD

Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	180003*	цилиндрический, с мандреном				
		Ch. 8/10	3 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см	10

* *Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

* *Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

WIRUTHAN®

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	331505*	цилиндрический				
		Ch. 6/8 Ch. 10/12	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 25 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH,
изготовленный из полиуретана, прозрачный

- с баллоном Rüsch Gold из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH SENSOR

Силикон




	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179360	цилиндрический				
		Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH SENSOR,
для измерения температуры, изготовленный из силикона, прозрачный

- цветовая кодировка термоусадочной муфты для простоты определения размера
- с заполненным шприцем в стерильной упаковке (3 мл/5 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАБЕЛИ-АДАПТЕРЫ BRILLANT

	НОМЕР	АДАПТЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179312	Медицинская штепсельная вилка 6,3 мм для приборов Siemens, Dräger, Datex, Hellige и т. д.	5,0 м	1
	179313	Круглая штепсельная вилка, 7-полюсная	3,5 м	1
	179314	Круглая штепсельная вилка HP 2-полюсная, для приборов Hewlett Packard	5,0 м	1
	179316	Cool Gard CG 3000, 2-полюсная	5,0 м	1

Примечание: Все кабели-адаптеры RÜSCH поставляются с бельевыми клипсами.

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

1.4 КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ,
изготовленный из силикона, прозрачный, с продольными бороздками для отведения уретрального секрета, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ



Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173420	наконечник открытого типа, длиной прибл. 4 см				
		Ch. 20 Ch. 22	20 мл 30 мл	6 дренажных отверстий, расположенных напротив	прибл. 40 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH SENSOR
для измерения температуры, изготовленный из силикона, прозрачный, двухходовый

- Цветовая кодировка термоусадочной муфты для простоты определения размера
- с заполненным шприцем в стерильной упаковке (3 мл/5 мл/10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH SENSOR



Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179360	цилиндрический				
		Ch. 8 Ch. 10 Ch. 12-18	3 мл 5 мл 10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см прибл. 30 см прибл. 44 см	5

Кабели-адаптеры см. стр. 13

КАТЕТЕР ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРЕТРЫ У ЖЕНЩИН,
изготовленный из силикона, прозрачный, двухходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- свободно перемещающийся конический
- рентгенконтрастный наконечник
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ





Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173705	цилиндрический, с тремя дренажными отверстиями для введения рентгенконтрастного вещества				
		Ch. 14	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	1

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

НАБОР ЦЕПОЧНОГО КАТЕТЕРА



	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	345500	Набор цепочного катетера			
		Зонд из белого полиуретана	Ch. 7	5 см	2
		Хромированная латунная цепочка с фиксирующим диском из силикона	Ch. 12	16 см	
		Оболочка из зеленого полиуретана	Ch. 7	24 см	

НАБОР ЦЕПОЧНОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРЕТРЫ У ЖЕНЩИН

Введение контрастного вещества, рентгенологическое исследование и сбор образца мочи с помощью одного инструмента.

- Инъектор контрастного вещества изготовлен из нержавеющей стали с переходником Luer-lock из ПВХ (длина прибл. 28 см)
- Вставной мандрен изготовлен из нержавеющей стали (длина прибл. 32,5 см)
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	333464*	цилиндрический			
		Ch. 18	10 мл	прибл. 41 см	10

КАТЕТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАКТИВНОСТИ, изготовленный из полиуретана, двухходовый

- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

** Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

1.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	204501	Регулируемый фланец	
		• для фиксации гемостатических катетеров • для катетеров размера Ch. 24 • стерильный, для однократного применения	5
	546000	Мандрен катетера, изготовленный из металла	
		• тип Томпсона (один конец прямой, второй — изогнутый) • диаметр 2,5 мм • длина прибл. 55 см • нестерильный	1
	548000	Заглушка катетера из синего ПВХ	
		• для размеров Ch. 7-30 • нестерильный • не содержит латекса	100
	548500	Заглушка катетера из синего ПВХ	
		• для размеров Ch. 7-30 • индивидуальная упаковка • с затупленным кончиком • стерильно, для однократного применения • не содержит латекса	50
	556000	SILKOSPRAY®	
		Silkospray® препятствует отложению солей на изделиях из резины, латекса и ПВХ, а также защищает их от прилипания к слизистой оболочке. Применяемый пропеллент не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ) и соответствует нормативным актам по защите окружающей среды.	10
		Хирургическая простыня для манипуляций на промежности, пластиковая	
	187501 187502	• без клейкой ленты • с клейкой лентой	50
		• стерильный, для однократного применения • **не содержит латекса**	
	850550	SilFlate, Заполненный шприц*	
		• со стерильным 10 % водным раствором глицерина • 10 мл • стерильно, для однократного применения ** Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!*	10

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

2 БЕЗБАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

2.1 КАТЕТЕРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)

КАТЕТЕРЫ

Поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	250100	асептический твердый наконечник			
		Ch. 6-22	1 дренажное отверстие	прибл. 37 см	5
	251500	наконечник в форме оливы			
		Ch. 8-18	1 дренажное отверстие	прибл. 37 см	5
	252000	тип Мерсье			
		Ch. 8-24	1 дренажное отверстие	прибл. 37 см	5
	254800	тип Кувелера, свисток			
		Ch. 14-26	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 37 см	10
	259700	тип Тимана			
		Ch. 6-24	1 дренажное отверстие	прибл. 37 см	5

КАТЕТЕРЫ,
изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ)

- красный
- с воронкой
- стерильный
- не содержит латекса

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

поливинилхлорид (ПВХ)




	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	220005	цилиндрический наконечник, силиконизированный, двойная упаковка, размер в соответствии с условными цветами			
		Ch. 8-16	1 дренажное отверстие	прибл. 16 см	50
	220006	цилиндрический наконечник, силиконизированный, одинарная упаковка, размер в соответствии с условными цветами			
		Ch. 8-16	1 дренажное отверстие	прибл. 16 см	50
	238000	цилиндрический наконечник, двойная упаковка			
		Ch. 8-16	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 18 см	100
	238300	цилиндрический наконечник, одинарная упаковка			
		Ch. 8-16	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 18 см	100

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН изготовлены из ПВХ

- прозрачные
- без воронки
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

РАЗМЕР ПО ШКАЛЕ ШАРЬЕРА В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ:



КАТЕТЕРЫ,
изготовленные
из поливинилхлорида (ПВХ)

- прозрачные
- с воронкой
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

КАТЕТЕРЫ


поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	220500	тип Нелатона-Робинсона, цилиндрический асептический твердый наконечник, силиконизированный, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 10-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50
	238500	тип Нелатона-Робинсона, цилиндрический наконечник, размер в соответствии с цветовой кодировкой воронки			
		Ch. 10-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	100
	221500	тип Кувелера, свисток, силиконизированный			
		Ch. 16-26	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10
	221800	тип Тимана, асептический твердый наконечник, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 12-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50
	221900	тип Тимана, асептический твердый наконечник, силиконизированный, 2 шт. в упаковке, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 12-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50

РАЗМЕР ПО ШКАЛЕ ШАРЬЕРА
В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ:



Ch. 10


Ch. 12



Ch. 14


Ch. 16


Ch. 18


Ch. 20


Ch. 22


Ch. 24

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

2.2 КАТЕТЕРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ РЕЗИНЫ

КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА

Мягкая резина



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	402100*	асептический твердый наконечник			
		Ch. 6-10/12-30	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10
	402101*	асептический твердый наконечник			
		Ch. 6-10/12-30	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10
	403300*	тип Робинсона, полый наконечник			
		Ch. 8-20	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10
	403900*	свисток			
		Ch. 8-22	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10
	404300*	наконечник открытого типа			
		Ch. 6-26	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕРЫ НЕЛАТОНА,
изготовленные из мягкой резины

- красный
- цилиндрический
- с воронкой
- стерильный

КАТЕТЕРЫ ТИМАНА

Резина Robusta



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	410200*	тип Тимана, асептический твердый наконечник			
		Ch. 7-10/12-28	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10
	410201*	тип Тимана, асептический твердый наконечник			
		Ch. 7-10/12-26	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕРЫ ТИМАНА,
изготовленные из мягкой резины

- красный
- с воронкой
- стерильный

САМОУДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ КАТЕТЕРЫ

Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КРЫЛЫШКИ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	415100*	тип Пеццера			
		Ch. 10-44	-	прибл. 35 см	5
	415600*	тип Каспера			
		Ch. 10-40	4	прибл. 40 см	5
	415700*	тип Малеко			
		Ch. 10-28	2	прибл. 40 см	5

САМОУДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ КАТЕТЕРЫ
изготовлены из латекса

- красный
- с воронкой
- стерильный, для однократного применения

** Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

3 НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

3.1 ОПИСАНИЕ



НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
187500	Стерильное содержимое: 1 салфетка из непромокаемой бумаги прибл. 76 x 46 см 1 лоток 1 пара виниловых перчаток размера XL 1 полиэтиленовая перчатка размера XL 1 пластиковый лоток с 6 марлевыми тампонами 2 марлевых тампонов размером 8 x 7,5 см 1 салфетка из непромокаемой бумаги с прорезью прибл. 76 x 46 см 1 пластиковый пинцет 1 контейнер с 5 г водорастворимого лубриканта стерильный, для однократного применения **не содержит латекса**	20

Около 90% всех инфекций мочевыводящих путей обусловлено установкой уретрального катетера. С каждым днем непрерывного стояния уретрального катетера Фолея риск бактериурии и инфекций мочевыводящих путей у пациентов увеличивается на 3—10 % Помимо того, что такие инфекции сами по себе создают угрозу для здоровья пациентов, они также создают большую экономическую проблему. Любая трансуретральная процедура несет в себе риск микробной контаминации. Поэтому крайне важно выполнять катетеризацию с соблюдением правил асептики, т.е. все мероприятия должны быть направлены на сохранение стерильности.

3.2 УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовку всех материалов, необходимых для катетеризации мочевого пузыря, следует выполнять с соблюдением правил асептики. Помощь второго лица поможет упростить подготовку и установку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: После информирования пациента о предстоящей катетеризации следует провести гигиенические мероприятия в области гениталий.
Затем пациента укладывают на спину. Попросите женщин согнуть ноги и поставить стопы. Подложите простынь под ягодицы пациента.
Затем обработайте свои руки дезинфицирующим средством.




ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА

1. Откройте комплект; наружную упаковку можно сохранить и использовать как мешок для утилизации. Расстелите внутреннюю упаковку и используйте ее в качестве стерильной рабочей поверхности.
2. Наденьте виниловые перчатки, а затем — полиэтиленовую перчатку.
3. Помощник может обеспечить стерильность всех дополнительных используемых материалов и в небольшом пластиковом лотке смочить дезинфицирующим средством для слизистой оболочки 6 марлевых тампонов.
   При необходимости катетер Фолея перед установкой можно присоединить к закрытому мочеприемнику.

ЭТАП 2: ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОСТЫНЬ С ПРОРЕЗЬЮ

1 Соблюдая правила асептики, поместите хирургическую простынь с прорезью на пациента пленкой вниз. У женщин прорезь должна быть направлена в сторону стоп, а у мужчин — в сторону головы.





2 Поставьте лоток в форме почки между ног у женщин и на ноги у мужчин.

ЭТАП 3: ОБРАБОТКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ

Обработайте дезинфицирующим раствором наружные половые органы.
Используйте каждый тампон только один раз!

♀ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ У ЖЕНЩИН

(после проведения гигиенических мероприятий области гениталий, если необходимо)

♂ 1-й и 2-й тампон: обработайте дезинфицирующим раствором правую и левую большие половые губы.
Всегда проводите обработку спереди назад!
3-й и 4-й тампон: обработайте дезинфицирующим раствором правую и левую малые половые губы.
Всегда проводите обработку спереди назад!
5-й тампон: обработайте уретру дезинфицирующим раствором
6-й тампон: закройте вход во влагалище, если необходимо

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ У МУЖЧИН

(после проведения гигиенических мероприятий области гениталий, если необходимо):
Сдвиньте крайнюю плоть. Обработайте всю головку полового члена, от уретры до ствола, с помощью всех 6 тампонов.

ЭТАП 4: КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

1. После обработки дезинфицирующим средством снимите полиэтиленовую перчатку.
   Убедитесь, что обе оставшиеся перчатки стерильны.
2. Хорошо увлажните наконечник катетера водорастворимым лубрикантом.
3. Рукой или пластиковым пинцетом осторожно введите катетер в уретру до появления мочи.
4. При установке постоянного катетера Фолея проводите его до тех пор, пока баллон наверняка окажется в мочевом пузыре.
   Заполните баллон максимальным объемом, указанным на воронке, и потяните катетер до ощущения легкого сопротивления.
   Мы рекомендуем заполнять баллоны стерильной водой.
   Баллоны силиконовых катетеров Фолея предпочтительно заполнять стерильным 10 % раствором глицерина.
   При установке постоянного катетера Фолея его следует подсоединить к стерильному закрытому мочеприемнику, если это не было сделано раньше.
5. У мужчин верните крайнюю плоть на место.

ЭТАП 5: ЗАВЕРШЕНИЕ

- Если необходимо, просушите область гениталий.
- Прикрепите мочеприемник к кровати, обязательно ниже уровня мочевого пузыря.
- Утилизируйте все материалы экологически приемлемым способом.
- В заключение обработайте руки дезинфицирующим средством!




4 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ

4.1 НАБОРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

EASYCYST ADULT

ЭКОНОМИЧНЫЙ КАТЕТЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА, ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО И СРЕДНЕГО ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ.

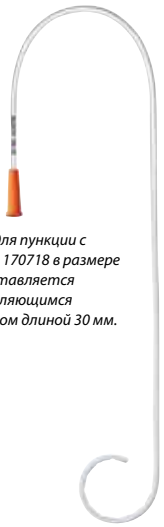

** Набор для пункции с номером 170718 в размере Ch. 8 поставляется с расщепляющимся троакаром длиной 30 мм.*

НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
170718*	**Набор для пункции**	
	Ch. 8/10/12/14/16	10
170717	**Сменный набор**	
	Ch. 8/10/12/14/16	10

С завитком типа пигтейл — без баллона

- хорошая способность к отведению мочи, несмотря на малый внешний диаметр, что достигается минимальной толщиной стенок
- хорошая совместимость благодаря малой склонности к отложению солей
- минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл
- малая травматичность благодаря небольшому внешнему диаметру (отсутствию баллона)
- безопасная фиксация швами без сдавления просвета благодаря сохраняющему форму полиуретану
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

SILFLATE

ЗАПОЛНЕННЫЙ ШПРИЦ*



НОМЕР	ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ	КОЛ-ВО
850550	**SilFlate**	
	10 мл	10

• со стерильным 10 % водным раствором глицерина

• стерильный, для однократного применения

*** Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!**

SUPRAFLEX ADULT

СИЛИКОНОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
170703	**Набор для пункции**	
	Ch. 10/12/14/16	5
170704	**Сменный набор**	
	Ch. 10/12/14/16	5

С завитком типа пигтейл и баллоном

- чрезвычайно высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря малой склонности к отложению солей и большому диаметру дренажных отверстий с внутренней стороны завитка типа пигтейл
- наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости
- минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл
- нет необходимости накладывать шов, поскольку катетер удерживается баллоном: минимальная травматичность
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

SUPRACATH ADULT

ЭКОНОМИЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ СИЛИКОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



**В размере Ch. 14-20 с рентгенконтрастным наконечником*

НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
170727*	**Набор для пункции**	
	Ch. 8/10/12/14/16	5
170729*	**Сменный набор**	
	Ch. 8/10/12/14/16	5
170606*	**Катетер отдельно**	
	Ch. 8/10/12/14/16/18/20	10

С наконечником открытого типа и баллоном

- высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря чрезвычайно малой склонности к отложению солей
- наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости
- исключительно простая и быстрая замена катетера по проводнику, благодаря прямому наконечнику открытого типа
- нет необходимости накладывать шов, поскольку катетер удерживается баллоном: минимальная травматичность
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

EASYCYST INFANT

ЭКОНОМИЧНЫЙ КАТЕТЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА, ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО И СРЕДНЕГО ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
170723	**Набор для пункции**	
	Ch. 5	5
170722	**Сменный набор**	
	Ch. 5	5

С завитком типа пигтейл — без баллона

- хорошая способность к отведению мочи, несмотря на малый внешний диаметр, что достигается минимальной толщиной стенок
- хорошая совместимость благодаря малой склонности к отложению солей
- минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл
- малая травматичность благодаря небольшому внешнему диаметру (отсутствию баллона)
- безопасная фиксация швами без сдавления просвета благодаря сохраняющему форму полиуретану
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

SUPRAFLEX INFANT


СИЛИКОНОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ У ДЕТЕЙ С НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
170702	**Набор для пункции**	
	Ch. 8/10	5

С завитком типа пигтейл — без баллона

- чрезвычайно высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря малой склонности к отложению солей и большому диаметру дренажных отверстий с внутренней стороны завитка типа пигтейл
- наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости
- минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА РАЗМЕРОВ ПУНКЦИОННЫХ ИГЛ, КАТЕТЕРОВ И БАЛЛОНА



Ch. 8 ≈ 3 мл | **Ch. 10 ≈ 3-5 мл** | **Ch. 12 ≈ 5-10 мл** | **Ch. 14 ≈ 5-10 мл** | **Ch. 16 ≈ 5-15 мл**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

4.2 ОБЗОР НАБОРОВ

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ БОЛЬШИНСТВО НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОСТОВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКЕ КАТЕТЕРА И ПУНКЦИОННОЙ ИГЛЫ ПОЗВОЛЯЕТ СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО СПОСОБНОСТИ К ОТВЕДЕНИЮ.



В набор входят:

- Катетер
- Мочеприемник① (не входит в набор EasyCyst Infant)
- Легко разделяемая пункционная игла
- Скальпель (не входит в набор EasyCyst Infant)
- Лейкопластырь
- Клипса или заглушка

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ

		КАТЕТЕР					ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА	
НОМЕР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОНФИГУРАЦИЯ	БАЛЛОН	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА	РАЗМЕР	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	КОЛ-ВО
170718②	**EASYCYST ADULT**	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	550 мм	Ch. 8	80 мм	10
170718	**EASYCYST ADULT**	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	550 мм	Ch. 10/12/14/16	120 мм	10
170703	**SUPRAFLEX ADULT**	Завиток типа пигтейл	баллон	силикон	510 мм	Ch. 10/12/14/16	120 мм	5
170727	**SUPRACATH ADULT**	Короткий, прямой наконечник	баллон	силикон	410 мм	Ch. 8/10/12/14/16	120 мм	5
170723	**EASYCYST INFANT**	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	500 мм	Ch. 5	70 мм	5
170702	**SUPRAFLEX INFANT**	Завиток типа пигтейл	–	силикон	480 мм	Ch. 8	80 мм	5
170702	**SUPRAFLEX INFANT**	Завиток типа пигтейл	–	силикон	480 мм	Ch. 10	120 мм	5

① мочеприемник объемом 2 л с антирефлюксным клапаном, Т-образным вентилем для опорожнения и подводящей трубкой длиной 90 см.
② Набор для пункции с номером 170718 в размере Ch. 8 поставляется с расщепляющимся троакаром длиной 30 мм.

СМЕННЫЕ НАБОРЫ

СМЕННЫЕ НАБОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗОПАСНО И БЫСТРО ЗАМЕНИТЬ КАТЕТЕР С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЮЩЕЙСЯ СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА. ДОСТОВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКЕ КАТЕТЕРА ПОЗВОЛЯЕТ СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО СПОСОБНОСТИ К ОТВЕДЕНИЮ.



В набор входят:

- Катетер
- Струна проводник с тефлоновым покрытием
- Лейкопластырь
- Клипса или заглушка

СМЕННЫЕ НАБОРЫ

		КАТЕТЕР					СТРУНА-ПРОВОДНИК	
НОМЕР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОНФИГУРАЦИЯ	БАЛЛОН	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
170717	EASYCYST ADULT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	550 мм	Ch. 8/10/12/14/16	1000 мм	10
170704	SUPRAFLEX ADULT	Завиток типа пигтейл	баллон	силикон	510 мм	Ch. 10/12/14/16	1000 мм	5
170729	SUPRACATH ADULT	Короткий, прямой наконечник	баллон	силикон	410 мм	Ch. 8/10/12/14/16	1000 мм	5
170722	EASYCYST INFANT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	500 мм	Ch. 5	1000 мм	5

4.3 НАБОР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПУНКЦИИ

SIMPLASTIC


ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКЦИИ И ОТВЕДЕНИЕ МОЧИ
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

НОМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
650704*	Инструмент для выполнения пункции	
	Ch. 10/12/16	5



Инструмент для выполнения экстренной пункции из ПВХ с латексным баллоном

- одноэтапное выполнение пункции и отведение мочи с помощью встроенного троакара и катетера
- точность выполнения пункции благодаря встроенному регулируемому троакару
- безопасная фиксация катетера с помощью баллона и фиксирующей пластины
- стерильный, для однократного применения



СКОРОСТЬ, КОГДА НА СЧЕТУ КАЖДАЯ СЕКУНДА
Нанесите местный анестетик, выполните небольшой разрез и введите инструмент для пункции: отвести мочу можно немедленно.

* *Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

5 МОЧЕПРИЕМНИКИ

5.1 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНЫЕ И ГИГИЕНИЧНЫЕ:
Около 90 % всех внутрибольничных инфекций мочевыводящих путей обусловлено тем или иным методом отведением мочи. Помимо того, что такие инфекции сами по себе создают угрозу для здоровья пациентов, они также создают большую экономическую проблему. Компания RÜSCH предлагает широкий ассортимент изделий для уменьшения риска инфицирования. Закрытые системы отведения мочи являются важнейшими мерами профилактики инфекций. Системы отведения мочи Rüsch отвечают всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к высококачественным закрытым системам для длительного применения в медицинских целях.

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ: МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАНДАРТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР



Снижение риска восходящих инфекций мочевыводящих путей: Соединение между катетером и закрытой системой для отведения мочи закрыто защитной пленкой во избежание непредвиденного рассоединения и связанной с ним бактериальной инвазии. (При необходимости пленку можно удалить)
Экономично и быстро: Не нужно ничего подсоединять — бережет время и уменьшает количество ошибок при катетеризации.

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ С СИЛИКОНОВЫМ БАЛЛОННЫМ КАТЕТЕРОМ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

	НОМЕР	СОСТАВ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс	171100	ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ		10
		Силиконовый баллонный катетер Rüsch Brillant	Ch. 12/14/16/18	
		цилиндрический твердый наконечник, 2 дренажных отверстия, расположенных напротив, длина прибл. 41 см, баллон 10 мл		
		Закрытая система для отведения мочи Rüsch S-Bag		
		емкостью 2000 мл, длина трубки 120 см		
		SilFlate – заполненный шприц*		
		со стерильным 10% водным раствором глицерина, 10 мл (номер 850550, чтобы заказать отдельно)		
		* Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!		



Силиконовый баллонный катетер Rüsch Brillant
- прозрачный двухходовый катетер с рентгенконтрастным наконечником и контрастной полоской вдоль стержня катетера
- силикон обеспечивает постоянную эластичность и биосовместимость
- большие дренажные отверстия и широкий внутренний просвет обеспечивают высокую эффективность отведения мочи
- минимальная склонность к отложению солей благодаря гладкой поверхности
- атравматичные наконечник и дренажные отверстия
- входящий в комплект заполненный шприц для раздувания баллона, в стерильной упаковке, содержащий 10 мл стерильного 10 % водногораствора глицерина

Rüsch S-Bag
- гофрированный универсальный разъем
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром
- герметичныйотводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой
- держатель для фиксации отводящей трубки

5.2 ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ

RÜSCH S-BAG

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

	НОМЕР		ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**	673044 673049	**Rüsch S-Bag** **Rüsch S-Bag A**	2000 мл	120 см	20



- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром
- герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой (номер 673044), или с Т-образным клапаном (номер 673049)
- держатель для фиксации отводящей трубки

Т-образный вентиль (номер 673049)



RÜSCH P-BAG

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ

	НОМЕР		ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс	673052	**Rüsch P-Bag**	1000 мл	90 см	20



- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром
- герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой
- держатель для фиксации отводящей трубки

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

RÜSCH U-BAG

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ СО ВСТРОЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ЕМКОСТЬЮ 400 МЛ

	НОМЕР		ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**	673064 673065	**Rüsch U-Bag**	2000 мл	120 см 150 см	10



- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- устанавливаемая поворотная двойная измерительная камера емкостью 400 мл со встроенной измерительной камерой емкостью 50 мл для измерения малых количеств мочи и дополнительный порт для забора свежих проб мочи
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на измерительной камере и мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет ленты Velcro и D-образного кольца
- герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой
- держатель для фиксации отводящей трубки

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

RÜSCH TUR-BAG

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

	НОМЕР		ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**	673053	**Rüsch TUR-Bag**	4000 мл	120 см	20



- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром
- точные показания благодаря сбалансированной конфигурации мочеприемника
- герметичный Т-образный вентиль на дне
- держатель для фиксации отводящей трубки

RÜSCH TUR-BAG С ГРУШЕЙ

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

	НОМЕР		ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**	673054	**Rüsch TUR-Bag**	4000 мл	120 см	10



- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром
- точные показания благодаря сбалансированной конфигурации мочеприемника
- герметичный Т-образный вентиль на дне
- держатель для фиксации отводящей трубки

5.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОЧЕПРИЕМНИК	МОЧЕПРИЕМНИК ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ СИСТЕМ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ И УТИЛИЗАЦИИ МОЧИ		
	НОМЕР	ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО
Нестерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**	673045	2000 мл	250



- пакет емкостью 2000 мл с градуировкой в мл
- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком, подходящий для всех систем отведения мочи с эластичной отводящей трубкой*
- скользящий зажим на приводящей трубке для закрытия мочеприемника

* Мочеприемник с номером 673045 идеально подходит для наших закрытых систем для отведения мочи: присоединенных систем (номер 171100), Rüsch S-Bag (номер 673044), Rüsch P-Bag (номер 673052), Rüsch U-Bag (номера 673064 и 673065), а также для всех других систем для отведения мочи с эластичными отводящими трубками. Обратите внимание: Мочеприемник номер 673045 нельзя использовать для опорожнения систем для отведения мочи с неэластичной отводящей трубкой.



Во время опрожнения система отведения мочи образует прочную и закрытую единицу с мочеприемником. Таким образом, удается избежать загрязнения окружающей области из-за пролития мочи. После опорожнения системы для отведения мочи мочеприемник можно закрыть скользящим зажимом и утилизировать.
Таким образом, вся процедура соответствует всем требованиям безопасности и гигиены, что является важным вкладом в профилактике распространения инфекций.

Мы предлагаем чистый и гигиеничный способ опорожнения систем отведения мочи и утилизации мочи.
Мочеприемник, который разработан специально для опорожнения системы отведения мочи и утилизации их содержимого путем подсоединения непосредственно к отводящей трубке системы. Таким образом удается избежать использования открытых контейнеров для сбора мочи и поддержать чистоту контейнера после каждого использования.

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

6 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

6.1 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE

Запатентованное гидрогелевое покрытие — решение при затрудненном проведении по мочеточнику

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с прямым наконечником						
 цилиндрический, закрытого типа	264701	ПВХ с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
 цилиндрический, закрытого типа	264702	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10
	для коаксиальной установки					
 наконечник открытого типа	264710	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 наконечник открытого типа	264711	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
с изогнутым наконечником						
 изогнутый наконечник в форме оливы	264801	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
	для коаксиальной установки					
 изогнутый наконечник открытого типа	264810	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264811	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10

Максимальный диаметр струны проводника для коаксиальных мочеточниковых SUPERGLIDE

НОМЕР 264710 / 264711 / 264810 / 264811					
Ch. 3	**Ch. 4**	**Ch. 5**	**Ch. 6**	**Ch. 7**	**Ch. 8**
0,018 дюйма	**0,028 дюйма**	**0,035 дюйма**	**0,038 дюйма**	**0,038 дюйма**	**0,038 дюйма**
0,45 мм	0,71 мм	0,89 мм	0,96 мм	0,96 мм	0,96 мм

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	263624-000050	**Удлиняющий мандрен**	1

Удлиняющий мандрен может быть подсоединен ко всем мочеточниковым катетерам SUPERGLIDE размера Ch. 5; при этом достигается удлинение рабочей части прибл. до 70 см. стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**

6.2 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с прямым наконечником						
цилиндрический, закрытого типа	263602	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-10	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223602	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223600	ПВХ, экстра-гладкий	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223606	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10
очень гибкий наконечник, цилиндрический, закрытого типа	333601	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-7	прибл. 70 см	2	10
наконечник в форме оливы	263702	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
наконечник в форме оливы	223706	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-6	прибл. 70 см	2	10
свисток	263802	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
	для коаксиальной установки					
наконечник открытого типа	264600	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3/4/4,8	прибл. 70 см	-	10
наконечник открытого типа	223604	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10

НОМЕР 264600			НОМЕР 223604			
Ch. 3	**Ch. 4**	**Ch. 4,8**	**Ch. 3**	**Ch. 4/5**	**Ch. 6**	**Ch. 7/8**
0,018 дюйма	**0,032 дюйма**	**0,038 дюйма**	**0,015 дюйма**	**0,018 дюйма**	**0,032 дюйма**	**0,045 дюйма**
0,45 мм	0,80 мм	0,96 мм	0,38 мм	0,45 мм	0,80 мм	1,14 мм

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых катетеров

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

Широкий выбор для диагностических и лечебных целей

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

Широкий выбор для диагностических и лечебных целей — в том числе при затруднении проведения по мочеточнику

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с изогнутым наконечником						
 изогнутый наконечник в форме оливы	264001	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1 20 мм от наконечника	10
	для коаксиальной установки					
 изогнутый наконечник открытого типа	264100	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264102	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-7	прибл. 70 см	1	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264200	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-6	Прибл. 115 см для уретеро- и реноскопов	-	6

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых катетеров

НОМЕР 264100			НОМЕР 264102		НОМЕР 264200		
Ch. 3	**Ch. 4**	**Ch. 5/6/7/8**	**Ch. 4**	**Ch. 5/6/7**	**Ch. 3**	**Ch. 4**	**Ch. 5/6**
0,015 дюйма	**0,018 дюйма**	**0,035 дюйма**	**0,018 дюйма**	**0,035 дюйма**	**0,015 дюйма**	**0,018 дюйма**	**0,028 дюйма**
0,38 мм	0,45 мм	0,89 мм	0,45 мм	0,89 мм	0,38 мм	0,45 мм	0,71 мм

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	263624-000050	**Удлиняющий мандрен**	1
	Удлиняющий мандрен может быть присоединен к изделиям с номерами 264100 и 264102 размера Ch. 5, удлинив их рабочую часть прибл. до 70 см. Стерильно, для однократного применения, **не содержит латекс**		

6.3 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
 Шевассю, свисток	267500	**Мочеточниковый катетер типа Шевассю для стандартного введения контрастного вещества в мочеточник во время ретроградного исследования.**				
		поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-12	прибл. 70 см	-	10
		Диаметр наконечника/стержня				

Наконечник	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9	Ch. 10	Ch. 11	Ch. 12
Стержень	Ch. 3	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 7	Ch. 7

 наконечник открытого типа	264500	**Мочеточниковый катетер, тип Вудруфа-Пфлаумера**				
		поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 5/8	прибл. 50 см	-	6

КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
 закрытого типа	324200*	**Мочеточниковый катетер, тип Пфлаумера**				
		мягкая резина	Ch. 6-10/12	прибл. 70 см	2	5

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Все под рукой для особых случаев

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**
- с градуировкой
- стерильный, для однократного применения

** Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, НОМЕР 267500



ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

6.4 ОККЛЮЗИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

** Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР
Для безопасной окклюзии мочеточника

- окклюзионный катетер, изготовленный из полиуретана
- с баллоном Rüsch Gold, изготовленным из латекса
- присоединяемый переходник Luer-lock с обратным клапаном
- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения

ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР, ОДНОПРОСВЕТНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
цилиндрический, закрытого типа	340700*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 3-5	прибл. 80 см	-	2

ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР, ДВУХПРОСВЕТНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
 изогнутый наконечник в форме оливы	340802*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 5-7	прибл. 80 см	1	2
	Для коаксиальной установки					
наконечник открытого типа	340800*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 4-7	прибл. 80 см	-	2

Максимальная емкость баллона


НОМЕР 340700 / 340800 / 340802					
	Ch. 3	**Ch. 4**	**Ch. 5**	**Ch. 6**	**Ch. 7**
Жидкость	0,3 мл	0,6 мл	1,5 мл	2,0 мл	2,5 мл
Воздух	0,6 мл	1,2 мл	3,0 мл	4,5 мл	5,0 мл


Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных окклюзионных катетеров

НОМЕР 340800	
Ch. 4	**Ch. 5/6/7**
0,015 дюйма	**0,035 дюйма**
0,38 мм	0,89 мм

6.5 СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ

СТРУНА-ПРОВОДНИК, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

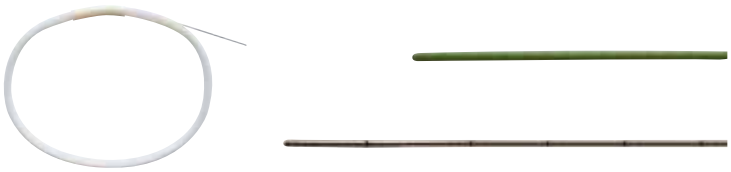


	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
 гибкий наконечник	264201	Струна-проводник с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником			
		нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие	2/3	прибл. 150 см	5
 Размер 2/3		Размер	2	3	
		Внутренний диаметр в дюймах	0,028 дюйма	0,035 дюйма	
		Внутренний диаметр в мм	0,71 мм	0,89 мм	
 гибкий наконечник	341002	Струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали, с сантиметровой градуировкой до 50 см			
		нержавеющая сталь	Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 150 см	2

СТРУНА-ПРОВОДНИК

- прямой гибкий безопасный наконечник
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

СТРУНА-ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОЛА

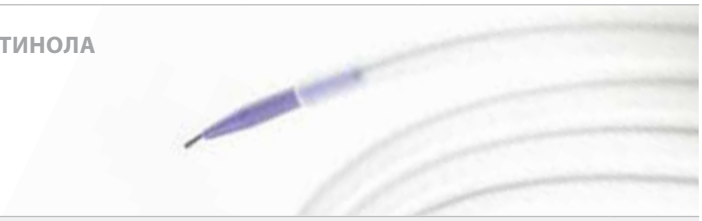

	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
 прямой и гибкий наконечник	680160-150035	Струна-проводник с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с толкателем и адаптером Luer-lock для увлажнения гидрофильной оболочки			
		Нитинол	Ø 0,035 дюйма (0,89 мм)	прибл. 150 см	5

СТРУНА-ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОЛА

Простота установки благодаря гидрофильному покрытию и точность использования благодаря нитиноловому сердечнику.

Для ультразвукового исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого типа или дилататоров.

- Высокая степень визуализации в затемненных кабинетах благодаря черному полиуретановому покрытию
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

6.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	547200	Переходник Luer-lock	
		• пластиковый, синий • присоединяемый • для размеров Ch. 3-7 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	547201	Переходник Luer-lock	
		• пластиковый, белый • присоединяемый • для размеров Ch. 7-12 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	340702	Переходник Luer-lock	
		• синий • обжатый • для размеров Ch. 3-6 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	340703	Переходник Luer-lock	
		• белый • обжатый • для размеров Ch. 6-10 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	526100	Адаптер	
		для подсоединения мочеточниковых катетеров к мочеприемникам • пластиковый, красный • для размеров Ch. 6-18 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	263624-000050	Удлиняющий мандрен	
		Удлиняющий мандрен может быть адаптирован под все катетеры SUPERGLIDE размера Ch. 5 и изделия с номерами 26 41 00 и 26 41 02 размера Ch. 5, удлиняя их рабочую часть прибл. до 70 см. Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс	1

7 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ

7.1 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ SUPERGLIDE

АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ КЛАПАН И DD-ЗАМОК SUPERGLIDE



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 26 СМ	28 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для одномоментной установки				
цилиндрический закрытого типа		335340	335341	4,8/6/7/8	5
	Для коаксиальной установки				
наконечник открытого типа		335440	335441	4,8/6/7/8	5

SUPERGLIDE DD




КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 22 СМ	24 СМ	26 СМ	28 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для одномоментной установки						
цилиндрический закрытого типа		– –	334846 –	334840 334940	334841 334941	4,8/6/7/8	5
	Для коаксиальной установки						
наконечник открытого типа		335142	335143	335140	335141	4,8/6/7/8	5

Максимальный диаметр струн-направителей для антирефлюксного клапана и DD-замка SUPERGLIDE и мочеточниковых стентов SUPERGLIDE DD с наконечником открытого типа

НОМЕР 335440 / 335441 НОМЕР 335142 / 335143 / 335140 / 335141			
Ch. 4,8	**Ch. 6**	**Ch. 7**	**Ch. 8**
0,028 дюйма	**0,028 дюйма**	**0,035 дюйма**	**0,035 дюйма**

Компоненты комплекта:


- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см, с DD-замком
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с наконечником закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте с наконечником открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ
изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием, с DD-замком, антирефлюксный клапан и зеленый маркер на везикальном конце

Полностью управляемый с антирефлюксным клапаном

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ DD
изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием, с DD-замком и зеленым маркером на везикальном конце

Полностью управляемый

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана,
с гидрогелевым покрытием

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия как указано в таблице
- как указано в таблице
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

** только для размеров Ch. 4,8/6/7/8*

SUPERGLIDE INTEGRAL



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 22 СМ	24 СМ	26 СМ	28 СМ	30 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		334246*	334250*	334247	334248	334249	4.8/6/7/8/9	5
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		334742*	334743*	334740	334741	–	4.8/6/7/8/9	5
наконечник открытого типа без струны-проводника		–	334744	334745	334746	–	4,8/6/7/8	5

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана,
с гидрогелевым покрытием

с мочеточниковым катетером SUPERGLIDE, наконечником открытого типа, Ch. 5, макс. внутр. диаметр 0,038 дюйма

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

SUPERGLIDE INTEGRAL PLUS



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 24 СМ	26 СМ	28 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для коаксиальной установки					
наконечник открытого типа		334751	334752	334753	4,8/6/7/8	5


Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с закрытым стентом, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов SUPERGLIDE открытого типа


НОМЕР 334742 / 334743 / 334740 / 334741 НОМЕР 334744 / 334745 / 334746 НОМЕР 334751 / 334752 / 334753				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюйма

SUPERGLIDE DD TUMOUR



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
		20 СМ	22 СМ	24 СМ	26 СМ	28 СМ		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		–	–	335524*	335526	335528	6/7	2
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		335620*	335622*	335624*	335626	335628	6/7/8**	2





МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ DD TUMOUR,
изготовленный из полиуретана, с гидрогелевым покрытием, с DD-замком и зеленым маркером на везикальном конце

Высокая устойчивость к перегибу в результате сдавления извне благодаря усилению прямой части стента особым армированным плетением.

Полностью управляемый

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

** только в размере Ch. 7*
*** только номер 335626 / 335628*


Максимальный диаметр струны-проводника для онкологических мочеточниковых стентов SUPERGLIDE DD открытого типа

НОМЕР 335620 / 335622 / 335624 НОМЕР 335626 / 335628		
Ch. 6	**Ch. 7**	**Ch. 8**
0,028 дюйма	**0,035 дюйма**	**0,035 дюйма**

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см, с DD-замком
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с наконечником закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте с наконечником открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

7.2 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ
изготовлен из полиуретана, с DD-замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце

Полностью управляемый с антирефлюксным клапаном


- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

С АНТИРЕНФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 22 СМ	24 СМ	26 СМ	28 СМ	30 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		335312*	335311	335300	335301	335302	4,8/6/7/8/9	5
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		–	335411	335400	335401	–	4,8/6/7/8	5

** упаковка с номером 335312 в размере Ch. 4,8 состоит из 2 единиц*



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С DD-ЗАМКОМ
изготовленный из полиуретана, с DD-замком на везикальном конце

Полностью управляемый

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

DD



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ 22 СМ	24 СМ	26 СМ	28 СМ	30 СМ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		334812 –	334811 –	334800 334900	334801 334901	334802 334902	4,8/6/7/8/9	5
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		335112 –	335111 –	335100 –	335101 335166	335102 –	4,8/6/7/8/9	5
	Для уретероренoскопов							
цилиндрический закрытого типа		–	–	335200	335201	–	4,8	5

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- Толкатель, изготовленный из полиуретана, длиной прибл. 45 см, с DD-замком (длина в комплекте с уретероренoскопами прибл. 90 см)
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте со стентом закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа и для уретероренoскопии
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка







Максимальный диаметр струны проводника для стентов с антирефлюксным клапаном и DD-замком со стентом открытого типа

НОМЕР 335411 / 335400 / 335401
НОМЕР 335112 / 335111 / 335100 / 335101 / 335102 / 335166

Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа 		334212	334211	334200	334201	334202	4,8/6/7/8/9	5
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа 		334710	334711	334702	334703	334714	4,8/6/7/8/9	5
	Для уретерореноскопов							
цилиндрический закрытого типа 		–	334213	334205	334206	–	4,8	5

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов с наконечником открытого типа

НОМЕР 334710 / 334711 / 334702 / 334703 / 334714				
Ch. 4,8	**Ch. 6**	**Ch. 7**	**Ch. 8**	**Ch. 9**
0,028 дюйма	**0,035 дюйма**	**0,035 дюйма**	**0,038 дюйма**	**0,038 дюйма**

Компоненты комплекта:


- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель, изготовленный из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см (длина в комплекте с уретерореноскопами прибл. 90 см)
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте со стентом закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа и для уретерореноскопов
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ, изготовленный из полиуретана, с ретракционной нитью на везикальном конце

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

7.3 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ
изготовлен из полиуретана, с DD-замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце

Полностью управляемый с антирефлюксным клапаном

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

С АНТИРЕНФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ




НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ						РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (Ch.)	КОЛ-ВО
	10 см	12 см	15 см	18 см	20 см	22 см		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа	335315	335309	335314	335310	335313	335312	4,8	2
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа	–	335413	335414	335415	335416	335417	4,8	2

Максимальный диаметр струны-проводника для детских мочеточниковых стентов с антирефлюксным клапаном и DD-замком с наконечником открытого типа

НОМЕР 335413 / 335414 / 335415 НОМЕР 335416 / 335417
Ch. 4,8
0,028 дюйма

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см, с DD-замком
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с наконечником закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте с наконечником открытого типа
- наборы для коаксиальной установки включают дополнительный мочеточниковый катетер с наконечником открытого для использования в качестве шины (см. таблицу)
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ, изготовленный из полиуретана, с антирефлюксным клапаном на везикальном конце

Антирефлюксный клапан

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

** только в размере Ch. 4*

С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ						РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	10 CM	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа	335316*	335303	335304	335305	335306	335307	3/4	2
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа	–	335403	335404	335405	335406	335407	3/4	2

Максимальный диаметр струны-проводника для детских мочеточниковых стентов с антирефлюксным клапаном и наконечником открытого типа

НОМЕР 335403 / 335404 / 335405 НОМЕР 335406 / 335407	
Ch. 3	**Ch. 4**
0,018 дюймы	**0,018 дюйма**

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с закрытым стентом, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа
- наборы для коаксиальной установки включают дополнительный мочеточниковый катетер с наконечником открытого для использования в качестве шины (см. таблицу)
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM		
	Для одномоментной установки						
цилиндрический закрытого типа	334207	334231	334245	334232	334263	3/4/4,8	5
	Для коаксиальной установки						
наконечник открытого типа	334700	334704	334705	334760	334706	3/4/4,8	5

Максимальный диаметр струны-проводника для детских интегральных мочеточниковых стентов с наконечником открытого типа

НОМЕР 334700 / 334704 / 334705 НОМЕР 334760 / 334706		
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4,8
0,018 дюйма	0,028 дюйма	0,028 дюйма

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с закрытым стентом, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

7

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Дети более чувствительны и острее переживают, чем взрослые. Имея многолетний опыт разработки мочеточниковых катетеров малых размеров и сверхтщательно контролируя процесс производства, вплоть до мельчайших деталей, компания Rüsch способствует уменьшению негативного влияния на ребенка таких вмешательств, как отведение мочи из почечной лоханки.

В наших стентах размера Ch. 3 достигнуто такое соотношение внутреннего и внешнего диаметра, которое позволяет добиться самого эффективного отведения мочи при максимальном комфорте применения. И, конечно же, эти стенты легко вводить и устанавливать.

Кроме того, в состав всех детских наборов мочеточниковых стентов с антирефлюксным клапаном и DD-замком для коаксиальной установки входят мочеточниковые катетеры с наконечником открытого типа в размере, позволяющим использовать их в качестве шины.

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

7.4 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- с одним завитком типа пигтейл и дренажными отверстиями только вдоль завитка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- Гибкая струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 150 см
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР С ОДНИМ ЗАВИТКОМ ТИПА ПИГТЕЙЛ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
цилиндрический закрытого типа 	334400	90 см	4,8/6/7/8/9	6
наконечник открытого типа 	334479	90 см	4,8/6/7/8/9	6

КАЖДЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ ТРИ СТЕНТА С ЗЕЛЕНЫМ МАРКЕРОМ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ И ТРИ СТЕНТА БЕЗ МАРКЕРОВ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ СТЕНТЫ С ОБЕИХ СТОРОН, МОЖНО УСТАНОВИТЬ ОДИН СТЕНТ С МАРКЕРОМ, А ВТОРОЙ — БЕЗ НЕГО. В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТА СЛЕДУЕТ ЧЕТКО ОТОБРАЗИТЬ, К КАКОЙ ПОЧКЕ ВЕДЕТ КАЖДЫЙ СТЕНТ.

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов с одним завитком типа пигтейл и наконечником открытого типа

НОМЕР 334479				
Ch. 4,8	**Ch. 6**	**Ch. 7**	**Ch. 8**	**Ch. 9**
0,028 дюйма	**0,035 дюйма**	**0.035 дюймы**	**0,038 дюйма**	**0.038 дюймы**


ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
изготовлен из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- с двумя завитками типа пигтейл закрытого типа, дренажными отверстиями, расположенными согласно таблице
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- усиленная струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием, длиной 100 см
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С НАКОНЕЧНИКАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА С ОБЕИХ СТОРОН





НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМАЯ ЧАСТЬ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
цилиндрические наконечники закрытого типа с обеих сторон 	334208 334209 334210	24 см 26 см 28 см	4,8/6/7 4,8/6/7/8/9 4,8/6/7/8/9	5

7.5 НАБОР МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА ECO

ECO



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	РАЗМЕР (CH.)	КОЛ-ВО
 наконечник открытого типа		310000-026048 310000-026060 310000-026070 310000-026080	26 см	4,8 6 7 8	10
		310000-028048 310000-028060 310000-028070 310000-028080	28 см	4,8 6 7 8	10
		310000-030048 310000-030060 310000-030070 310000-030080	30 см	4,8 6 7 8	10
 цилиндрический закрытого типа		310001-026048 310001-026060 310001-026070 310001-026080	26 см	4,8 6 7 8	10
		310001-028048 310001-028060 310001-028070 310001-028080	28 см	4,8 6 7 8	10
		310001-030048 310001-030060 310001-030070 310001-030080	30 см	4,8 6 7 8	10

НАБОР МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА ECO,
изготовленный из полиуретана

- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

Компоненты комплекта:
- мочеточниковый стент
- без проводника
- толкатель длиной прибл. 45 см
- стерильная упаковка

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов ECO с наконечником открытого типа

НОМЕР 310000			
Ch. 4,8	**Ch. 6**	**Ch. 7**	**Ch. 8**
0,028 дюйма	**0,035 дюйма**	**0,038 дюйма**	**0.038 дюймы**
0,71 мм	0,89 мм	0,96 мм	0,96 мм

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

8 НЕФРОСТОМИЯ

8.1 НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ SUPERGLIDE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 2-ЭТАПНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ



Номер 340012

РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА		ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЕТ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА			
Ch. 6	19,5 G/0,95 мм	120 мм	0,028 дюйма	0,75 мм/0,029 дюйма	1
Ch. 8	17,5 G/1,30 мм	200 мм	0,038 дюйма	1,00 мм/0,039 дюйма	
Ch. 10	17,5 G/1,30 мм	200 мм	0,038 дюйма	1,00 мм/0,039 дюйма	

Компоненты комплекта:

- Пункционная игла из 2 частей с ультразвуковой меткой на наконечнике (3 маркировочных кольца)
- жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм
- удлинитель катетера, изготовленный из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном
- катетер с завитком типа пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной прибл. 30 см, с наконечником открытого типа, гидрогелевым покрытием, 6 дренажными отверстиями, желобками для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-lock
- Переходник LL с краном
- адаптер для мочеприемника(комбинация LL-воронка)
- 3 наклейки для документации
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ SUPERGLIDE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 3-ЭТАПНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ



Номер 340013

РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА		ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА	ДИЛАТАТОР/РАЗДЕЛЯЕМОЙ ОБОЛОЧКОЙ		КОЛ-ВО
	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА		ДЛИНА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИЛАТАТОРА	
Ch. 6	19,5 G/0,95 мм	120 мм	0,028 дюйма	175/162,4 мм	Ch. 10	1
Ch. 8	17,5 G/1,30 мм	200 мм	0,038 дюйма	175/160,1 мм	Ch. 12	
Ch. 10	17,5 G/1,30 мм	200 мм	0,038 дюйма	175/157,8 мм	Ch. 14	

Компоненты комплекта:

- пункционная игла из 2 частей с ультразвуковой меткой на наконечнике (3 маркировочных кольца)
- жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм
- дилататор из 2 частей, с открытым наконечником, длиной прибл. 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный
- катетер с завитком типа пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной прибл. 30 см, с наконечником открытого типа, с 6 дренажными отверстиями, желобками для наложения швов на дренаже, удлинителем завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-lock
- переходник LL с краном
- адаптер для мочеприемника (комбинация LL-воронка)
- 3 наклейки для документации
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

8.2 СМЕННЫЕ НАБОРЫ

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SUPERGLIDE ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Номер 340014



РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА	УДЛИНИТЕЛЬ КАТЕТЕРА ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	0,028 дюйма 0,038 дюйма 0,038 дюйма	0,75 мм/0,029 дюйма 1,00 мм/0,039 дюйма 1,00 мм/0,039 дюйма	1

Компоненты комплекта:

- жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм
- удлинитель катетера, изготовленный из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном
- катетер с завитком типа пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной прибл. 30 см, с наконечником открытого типа, гидрогелевым покрытием, 6 дренажными отверстиями, желобками для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-lock
- переходник LL с краном
- адаптер для мочеприемника (комбинация LL-воронка)
- 3 наклейки для документации
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**



НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
546476	Адаптер для мочеприемника	10

Адаптер (комбинация LL-воронка) совместим со всеми доступными на рынке мочеприемниками

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

8.3 MIPP-НАБОР

Для малоинвазивных чрескожных вмешательств

- Активируйте гидрогелевое покрытие путем погружения в стерильный физраствор или дистиллированную воду.
- Проведите дилататор размера Ch./Fr. 9 по струне-проводнику к требуемому месту Проверьте правильность расположения с помощью рентгенологического исследования.
- Проведите дилататор размера Ch./Fr. 14 поверх дилататора размера Ch./Fr. 9 непосредственно к требуемому месту, а затем — до занятия им необходимого положения.
- По инструменту подведите к месту ренальный кожух.
- По очереди извлеките оба дилататора (Ch./Fr. 9 и 14), удерживая на своих местах струну-проводник и ренальный кожух.

- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

MIPP-НАБОР	НОМЕР 341200-000140		КОЛ-ВО 1	
	РАЗМЕР ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	МАКС. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
	Пункционная игла из 2 частей с ультразвуковой меткой на конце (3 маркировочных кольца)			
	–	200 мм	0,038 дюйма	17,5 G
	Жесткая струна-проводник в диспенсере, с толкателем, гибким J-образным наконечником			
	0,038 дюйма	1000 мм	–	–
	Дилататор Superglide, с сантиметровой градуировкой, гидрогелевым покрытием на протяжении 30 см			
	Ch./Fr. 9	540 мм	0,038 дюйма	–
	Дилататор Superglide , с сантиметровой градуировкой, наконечником открытого типа для дилататора Ch./Fr. 9, рентгенконтрастный, с гидрогелевым покрытием на протяжении 25 см			
	Ch./Fr. 14	320 мм	–	–
	Ренальный кожух Superglide, рентгенконтрастный, с гидрогелевым покрытием на протяжении 50 мм			
	–	160 мм	Ch./Fr. 14	–
	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, изготовленный из силикона, с рентгенконтрастным наконечником открытого типа, гидрогелевым покрытием на протяжении 50 мм, с полым мандреном, емкость баллона 3 мл*			
	Ch./Fr. 12	410 мм	0,038 дюйма	–
	* *Заполняйте баллоны баллонных катетеров стерильной водой до фиксации катетера в почечной лоханке. Для заполнения баллона используйте шприц Luer или Luer-lock Объем заполнения указан на воронке катетера или этикетке упаковки.*			

ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Все чаще для диагностики и лечения, в том числе и для удаления фрагментов камней из чашечек почек, применяются мининефроскопы.

MIPP набор от компании Rüsch прекрасно подходят для этого дружественного к пациентам направления. Он включает все инструменты, необходимые для выполнения малоинвазивных чрескожных вмешательств, — от пункционной иглы, струны-проводника и дилататоров до баллонного катетера для нефростомии.

Гидрогелевое покрытие дилататоров, ренального кожуха и катетера значительно облегчает работу с ними.

8.4 ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ



	НОМЕР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	340002-120175	из 3 частей, с ультразвуковой маркировкой на наконечнике (3 кольца)			
		17,5 G	0,038 дюйма	120 мм	5
	340002-200230	Тонкая, состоящая из 2 частей,для соответствия изделию номер 340002-120175			
		23 G	–	200 мм	5
	340003-200175	из 3 частей, с ультразвуковой маркировкой на наконечнике (3 кольца)			
		17,5 G	0,038 дюйма	200 мм	5
	340003-280230	Тонкая, состоящая из 2 частей,для соответствия изделию номер 340003-200175			
		23 G	–	280 мм	5
	340057-000000	из 2 частей, для двухэтапной нефростомии			
		17,5 G	0,038 дюйма	200 мм	2

ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

Безопасное обращение

- ультразвуковая метка на конце (3 маркировочных кольца)
- из 2 или из 3 частей
- для двух- или трехэтапной нефростомии
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

8.5 СТРУНА-ПРОВОДНИК

СТРУНА-ПРОВОДНИК

Атравматичная и точная

- плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику
- тефлоновое покрытие
- жесткий проксимальный конец
- дистальный наконечник, прямой или J-образный
- в диспенсере, с толкателем
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ЖЕСТКАЯ СТРУНА-НАПРАВИТЕЛЬ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ





НОМЕР	ДЛИНА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
СТРУНА-ПРОВОДНИК жесткая, прямой наконечник			
680141-000028 680141-000035 680141-000038	800 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
680143-000028 680143-000035 680143-000038	1000 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
680145-000028 680145-000035 680145-000038	1200 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
СТРУНА-ПРОВОДНИК жесткая, изогнутый наконечник			
680151-000028 680151-000035 680151-000038	800 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
680153-000028 680153-000035 680153-000038	1000 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
680155-000028 680155-000035 680155-000038	1200 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5




ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

8.6 ДИЛАТАТОРЫ/РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ/КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

НАБОР ДИЛАТАТОРА ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Полиуретан

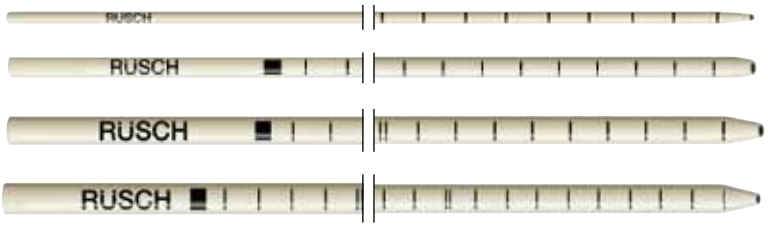




НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НАКОНЕЧНИКА	КОЛ-ВО
Набор дилататоров				
340200	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 мм 360 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма 3,1 мм	1
Дилататоры в индивидуальной упаковке				
340201	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 мм 360 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма 3,1 мм	10

НАБОР ФАСЦИАЛЬНЫХ ДИЛАТАТОРОВ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Полиуретан





НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НАКОНЕЧНИКА	КОЛ-ВО
Набор фасциальных дилататоров				
340900	6-28*	320 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма	1
Фасциальные дилататоры в индивидуальной упаковке				
340901	6-36*	320 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма	5

РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ

поливинилхлорид (ПВХ)



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
Ренальные кожухи			
341100	20-36*	160 мм	5

НАБОР ДИЛАТАТОРОВ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Простое обращение, безопасная установка

- дилататоры, изготовленные из полиуретана
- для чрескожной нефростомии, для установки катетеров для почечной фистулы
- дилататоры Ch./Fr. 12–29, с просветом 3,1 мм, длиной прибл. 360 мм
- дилататор Ch./Fr. 9, с просветом 1,05 мм (0,041 дюйма), длиной прибл. 540 мм
- дилататоры с просветом 3,1 мм устанавливаются поверх дилататора Ch./Fr. 9
- наконечники конической формы
- сантиметровая градуировка
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ФАСЦИАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

изготовлен из полиуретана

- белые (Ch./Fr. 14 = серый)
- наконечники конической формы
- сантиметровая градуировка
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

** только четные размеры*

РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ

изготовлены из ПВХ

- применяются как гибкая оболочка для нефроскопа
- скошенный наконечник (60°)
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**


** только четные размеры*

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ
изготовлены из силикона, с полым металлическим мандреном

- наконечник открытого типа, установка по струне-проводнику диаметром до 0,038 дюйма
- гидрогелевое покрытие на протяжении первых 5 см
- дренажное отверстие впереди и позади баллона
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- цилиндрический рентгенконтрастный наконечник
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE

Силикон

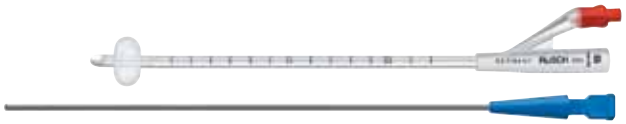



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДЛИНА	КОЛ-ВО
Баллонный нефростомический катетер Superglide с полым металлическим мандреном				
340408 340408 340409 340409	Ch. 12-14 Ch. 16-24 Ch. 12-14 Ch. 16-24	3 мл 5 мл 3 мл 5 мл	240 мм 240 мм 410 мм 410 мм	5

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ,
изготовленные из силикона, с отсоединяемой и неотсоединяемой воронкой

- наконечник открытого типа, рентгенконтрастный
- 2 дренажных отверстия впереди и 2 — позади баллона
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- Номер 340502: сменный катетер для изделия номер 340500
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Силикон





НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДЛИНА	КОЛ-ВО
340500	с отсоединяемой воронкой			
	Ch. 12-14 Ch. 16-24	3 мл 5 мл	450 мм	5
340502	с неотсоединяемой воронкой			
	Ch. 12-14 Ch. 16-24	3 мл 5 мл	450 мм	5

КАТЕТЕР ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ ФИСТУЛЫ,
изготовленный из силикона

- наконечник открытого типа
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ДЛЯ РЕНАЛЬНОЙ ФИСТУЛЫ

Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
179800	Ch. 10-24	400 мм	1	5

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ



Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНТА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
179000-120040	Ch. 12x4	400 мм	0,6 мм/0,023 дюйма	2	5
179000-140050	Ch. 14x5		0,8 мм/0,031 дюйма		
179000-160060	Ch. 16x6		0,8 мм/0,031 дюйма		
179000-160080	Ch. 16x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
179000-180080	Ch. 18x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
179000-200080	Ch. 20x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
179000-220080	Ch. 22x8		1,3 мм/0,050 дюйма		

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ,
изготовленный из силикона

- мочеточниковый стент (Ch./Fr. 4/5/6/8), длиной прибл. 35 см
- стент открытого типа
- прозрачные
- сантиметровая градуировка катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ



Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНТА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
179005-120040	Ch. 12x4	3 мл	410 мм	0,6 мм/0,023 дюйма	2	1
179005-140050	Ch. 14x5	3 мл		0,8 мм/0,031 дюйма		
179005-160060	Ch. 16x6	5 мл		0,8 мм/0,031 дюйма		
179005-160080	Ch. 16x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
179005-180080	Ch. 18x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
179005-200080	Ch. 20x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
179005-220080	Ch. 22x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
179005-240080	Ch. 24x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ,
изготовленный из силикона

- мочеточниковый стент (Ch./Fr. 4/5/6/8), длиной прибл. 35 см
- стент открытого типа
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- прозрачные
- сантиметровая градуировка баллонного катетера
- рентгенконтрастный наконечник катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР С ОТСОЕДИНЯЕМОЙ ВОРОНКОЙ



Полиуретан



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КАТЕТЕРА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
340300	Ch. 12	470 мм	1,0 мм/0,039 дюйма	2	5
	Ch. 14		1,0 мм/0,039 дюйма		
	Ch. 16		1,2 мм/0,047 дюйма		
	Ch. 18		1,2 мм/0,047 дюйма		
	Ch. 20		1,4 мм/0,055 дюйма		
	Ch. 22		1,4 мм/0,055 дюйма		
	Ch. 24		1,4 мм/0,055 дюйма		
	Ch. 26		1,4 мм/0,055 дюйма		

КАТЕТЕР С ОТСОЕДИНЯЕМОЙ ВОРОНКОЙ,
изготовленный из полиуретана

- наконечник открытого типа, рентгенконтрастный
- контрастная полоса по всей длине
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

** Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР,
изготовленный из мягкой резины

- красный
- наконечник открытого типа
- проксимальный конец в форме воронки
- 1 дренажное отверстие
- содержит латекс
- стерильный


НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР

Мягкая резина


	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КАТЕТЕР	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	404300*	Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10 Ch. 12 Ch. 14 Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24 Ch. 26	400 мм	0,9 мм/0,035 дюйма 1,4 мм/0,055 дюйма 1,8 мм/0,047 дюйма 2,0 мм/0,078 дюйма 2,2 мм/0,086 дюйма 2,6 мм/0,102 дюйма 2,8 мм/0,110 дюйма 3,2 мм/0,125 дюйма 3,4 мм/0,133 дюйма 4,0 мм/0,157 дюйма 4,6 мм/0,181 дюйма	1	10

ВВЕДЕНИЕ — БЕЗОПАСНОЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ


Надлобковая цистостомия

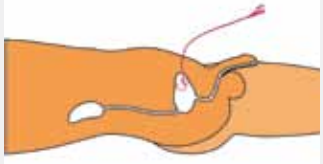


Мочеточниковый катетер

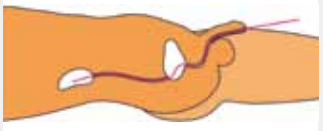

Мочеточниковый стент

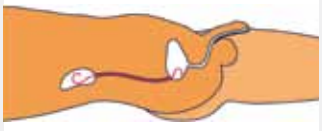


Нефростомия

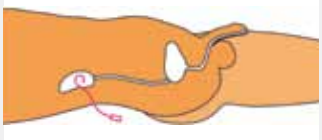


9 ЭКСТРАКТОРЫ КАМНЕЙ


9.1 КОРЗИНЫ С НИТЯМИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ

RÜSCH-STONEX®
4F

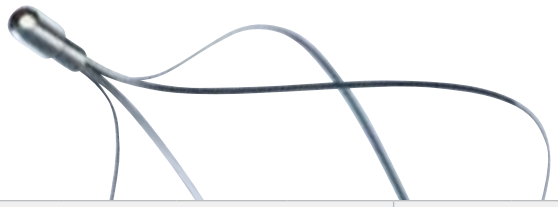

	АРТ. (КОЛ-ВО 1)					АРТ. (КОЛ-ВО 5)	
	ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА Ø	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОРЗИНА ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	КОРЗИНА ДЛИНА	ЗАПАСНАЯ ОБОЛОЧКА	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
RÜSCH-STONEX® 4F с 4 нитями плоского сечения, с цилиндрическим наконечником							
	342700	Ch. 2,5	90 см	15 мм	20 мм	343030	Ch. 2,5
	342900	Ch. 2,5	115 см	15 мм	20 мм		
	342700	Ch. 3	90 см	20 мм	25 мм	343030	Ch. 3
	342900	Ch. 3	115 см	20 мм	25 мм		
	342700	Ch. 4	90 см	20 мм	25 мм	341730	Ch. 4
RÜSCH-STONEX® 4F с 4 нитями плоского сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана							
	342800	Ch. 4	90 см	20 мм	25 мм	341730	Ch. 4

ГАБАРИТЫ

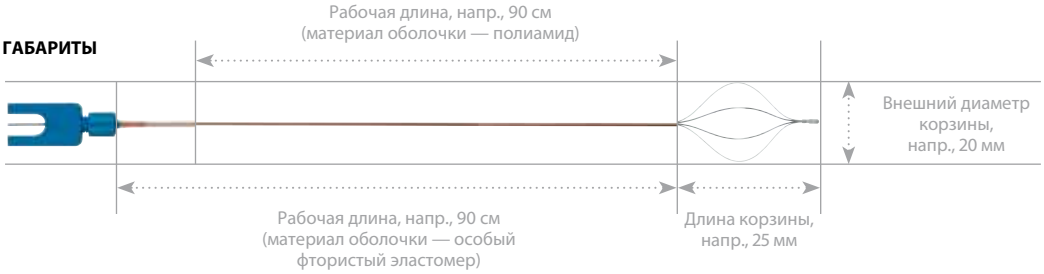

RÜSCH-STONEX С НИТЯМИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ КОРЗИНЫ
с симметричной внешней формой для точных манипуляций с камнями, даже в самых сложных условиях.

- атравматичные наконечники
- корзины с сохраняющими форму с нитями плоского сечения из нержавеющей стали, с симметричной внешней формой
- манипуляция одной рукой
- присоединяемый держатель
- рентгенконтрастный
- блистерная упаковка
- материал оболочки: полиимид или особый фтористый эластомер
- оболочка: для однократного применения
- стерильный
- **не содержит латекса**


ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

9.2 КОРЗИНЫ С НИТЯМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

КОРЗИНЫ RÜSCH-STONEX С НИТЯМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ предлагает широкий выбор вариантов, подходящих для камней любого размера и формы.


- атравматичные наконечники
- корзины с сохраняющими форму нитями круглого сечения из нержавеющей стали, со спиралевидной внешней формой
- манипуляция одной рукой
- присоединяемый держатель
- оболочка с сантиметровой градуировкой и рабочей длиной 65 см
- рентгенконтрастный
- блистерная упаковка
- материал оболочки: полиимид или особый фтористый эластомер
- оболочка: для однократного применения
- стерильный
- **не содержит латекса**

RÜSCH-STONEX®
4R
5R
6R

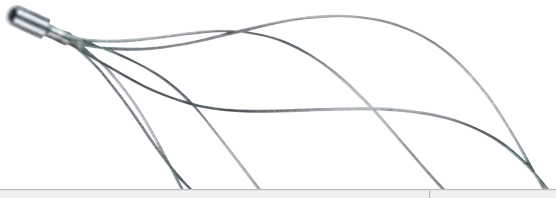

	АРТ. (КОЛ-ВО 1)					АРТ. (КОЛ-ВО 5)	
	ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА Ø	РАБОЧАЯ ДЛИНА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОРЗИНЫ	ДЛИНА КОРЗИНЫ	ЗАПАСНАЯ ОБОЛОЧКА	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
RÜSCH-STONEX® 4 R с 4 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником							
	341450	Ch. 2,5	90 см	12 мм	20 мм	343030	Ch. 2,5
	341400	Ch. 2,5	115 см	12 мм	20 мм		
	341500	Ch. 3	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 3
	341450	Ch. 3	90 см	20 мм	40 мм	341730	Ch. 3
	341400	Ch. 3	115 см	20 мм	40 мм	341760	Ch. 3
	341500	Ch. 4	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 4
	341500	Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 5
RÜSCH-STONEX® 4 R с 4 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана							
	341600	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 4 Ch. 5
RÜSCH-STONEX® 5R с 5 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником							
	341401	Ch. 3	115 см	20 мм	40 мм	341760	Ch. 3
	341501	Ch. 4	65 см			341700	Ch. 4
	341501	Ch. 5	65 см			341700	Ch. 5
RÜSCH-STONEX® 5R с 5 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана							
	341601	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 4 Ch. 5
RÜSCH-STONEX® 6R с 6 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником							
	341402	Ch. 3	115 см	20 мм	40 мм	341760	Ch. 3
	341502	Ch. 4	65 см			341700	Ch. 4
	341502	Ch. 5	65 см			341700	Ch. 5
RÜSCH-STONEX® 6 R с 6 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана							
	341602	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм	341700	Ch. 4 Ch. 5

ГАБАРИТЫ

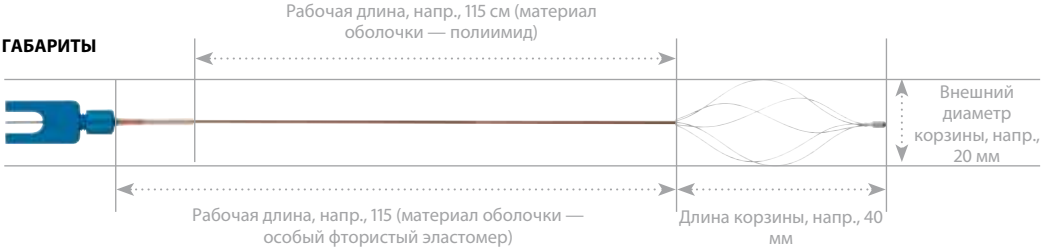

10 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ УРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10.1 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЦИСТОМЕТРОГРАФИИ/ КОМБИНИРОВАННОЙ УРЕТРОЦИСТОМЕТРОГРАФИИ

ZYS 200 / 210

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	ZYS 200, цилиндрический				
	395751-072000 395751-074000 395751-092000 395751-094000	Ch. 7 Ch. 7 Ch. 9 Ch. 9	20 см 40 см 20 см 40 см	3	10
	ZYS 210, тип Тимана				
	395751-072010 395751-074010 395751-092010 395751-094010	Ch. 7 Ch. 7 Ch. 9 Ch. 9	20 см 40 см 20 см 40 см	3	10

F = отверстие просвета заполнения
M = измерительное отверстие






* синий = канал заполнения (F),
красный = измерительный канал (M)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР
из полиуретана для цистометрографии, двухходовый

- просвет между измерительным отверстием и наконечником перекрыт
- правильное подключение к измерительному оборудованию обеспечивается цветовой кодировкой насадок*
- скорость потока заполнения канала: до 100 мл/мин
- малый диаметр катетеров уменьшает растяжение уретры
- тонкостенный, безусадочный материал
- простая утилизация
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

поливинилхлорид (ПВХ)

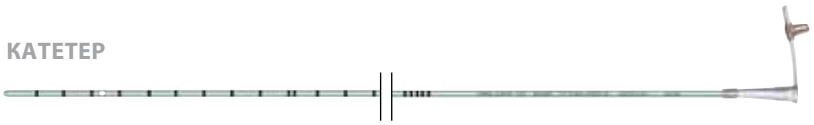


	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
цилиндрический	395766	Ch. 8	39 см	2	10

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР из ПВХ,
однопросветный, для измерения профиля давления в уретре

- универсальный переходник с герметичным колпачком
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

поливинилхлорид (ПВХ)

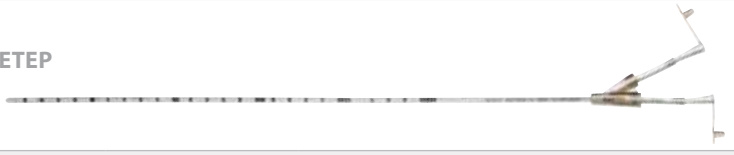

	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
цилиндрический	395767	Ch. 8/10/12	43 см	2	10

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР из ПВХ,
двухпросветный, для заполнения мочевого пузыря и измерения давления

- универсальные переходники с герметичными колпачками
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАТЕТЕР
из полиуретана для комбинированной уретроцистометрографии, трехходовый


- измерение давления внутри мочевого пузыря и профиля давления в уретре проводится одним и тем же катетером по разным каналам
- соответствующий просвет между перфузионным/измерительным отверстием и наконечником закрывается
- скорость потока заполнения канала: до 100 мл/мин. Максимальное значение, измеренное в перфузионном и измерительном канале, равно 9 мл/мин (соответствует катетеру размера 9 Ch)
- правильное подключение к измерительному оборудованию обеспечивается цветовой кодировкой насадок*
- Перфузионное и измерительное отверстия расположены внутри оболочки. Таким образом, получается замкнутое пространство между катетером и уретрой, в котором поддерживается постоянное давление, что обеспечивает точное измерение давления.
- простая утилизация
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**


ZYS 302 / 312

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	**ZYS 302, цилиндрический**				
	395752-072002 395752-074002 395752-092002 395752-094002	Ch. 7 Ch. 7 Ch. 9 Ch. 9	20 см 40 см 20 см 40 см	3	5
	**ZYS 312, тип Тимана**				
	395752-072012 395752-074012 395752-092012 395752-094012	Ch. 7 Ch. 7 Ch. 9 Ch. 9	20 см 40 см 20 см 40 см	3	5

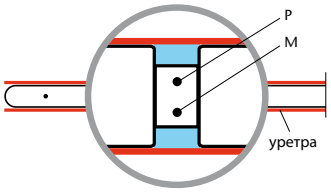





F = отверстие просвета заполнения
M = измерительное отверстие
P = перфузионное отверстие

** синий = канал заполнения (F), красный = измерительный канал (M), желтый = перфузионный канал (P)*

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

10.2 РЕКТАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

ZYS 502

поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	**наконечник открытого типа**			
	395753-182702	Ch. 18	27 см	5

РЕКТАЛЬНЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР,
изготовленный из ПВХ, двухпросветный

- перфорированная оболочка внутри баллона
- с клипсой
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ZYS 520

поливинилхлорид (ПВХ)

	НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	**наконечник открытого типа**			
	395753-101020	Ch. 10	100 см	5

РЕКТАЛЬНЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР
для детей, изготовленный из ПВХ, однопросветный

- перфорированная оболочка внутри баллона
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

РЕКТАЛЬНЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР

ПВХ/Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	**наконечник открытого типа**				
	395763*	Ch. 14	42 см	1	10

РЕКТАЛЬНЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР,
изготовленный из ПВХ, с латексным баллоном, однопросветный

- облочка с 1 дренажным отверстием внутри латексного баллона
- универсальный переходник с герметичным колпачком
- стерильный, для однократного применения

** Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

11 ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11.1 БУЖИ


СОСТАВ НАБОРА КАТЕТЕРА ДЕЛЕФОССЕ:

Катетер, изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ), красный
- метрический винт
- 1 дренажное отверстие
- стерильный
- не содержит латекса

Буж-проводник (нитевидный буж), изготовленный из ПВХ, красный
- метрическая гайка
- наконечник в форме оливы
- стерильный
- **не содержит латекса**

НАБОР КАТЕТЕРА ДЕЛЕФОССЕ

поливинилхлорид (ПВХ)

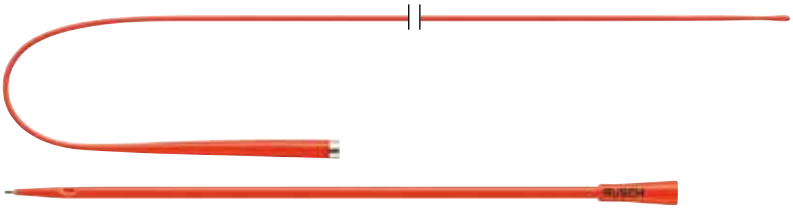

	НОМЕР	КАТЕТЕР		БУЖ-ПРОВОДНИК		КОЛ-ВО
		РАЗМЕР	ДЛИНА	РАЗМЕР	ДЛИНА	
	Набор катетера Делефоссе					
	252600-000120 252600-000140 252600-000160 252600-000180 252600-000200	Ch. 12 Ch. 14 Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20	прибл. 37 см	Ch. 1 Ch. 2 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 3	прибл. 33 см	2

НИТЕВИДНЫЙ БУЖ,
изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ), красный

- метрическая гайка
- наконечник в форме оливы
- совместим с изделием номер 252600
- **не содержит латекса**

НИТЕВИДНЫЙ БУЖ

поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	Буж-проводник, наконечник в виде оливы			
	277100	Ch. 1-6	прибл. 33 см	2

БУЖ

поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	Буж, наконечник в виде оливы			
	270300	Ch. 7-24	прибл. 37 см	2

БУЖ,
изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ), красный, твердый

- наконечник в форме оливы
- не содержит латекса

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

11.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УРЕТРАЛЬНОГО ДИЛАТАТОРА
для лечения стриктур уретры и для дилатации уретры в послеоперационном периоде после внутренней уретротомии.

- двухходовый дилататор, изготовленный из полиуретана
- белый, рентгенконтрастный
- со специальным армированным баллоном, изготовленным из латекса, давление наполнения баллона 5 бар
- полый мандрен и антирефлюксный клапан с наконечником шприца Luer-lock
- двухходовый кран
- удлинительная трубка, изготовленная из ПВХ, прозрачный, переходники Luer-lock (с внутренним и наружным конусом), длиной прибл. 50 см
- входящий в набор одноразовый шприц
- стерильный, для однократного применения

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	БАЛЛОН	КОЛ-ВО
 конический. открытого типа для коаксиальной установки	342100*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 40 см	8,0 мл длина 15 см	1
	342101*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 12:22	прибл. 40 см	5,0 мл длина 15 см	1
	342102*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 50 см	13,0 мл длина 20 см	1
 Тип Тимана, 1 дренажное отверстие	342200*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 40 см	8,0 мл длина 15 см	1
	342201*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 12:22	прибл. 40 см	5,0 мл длина 15 см	1
	342202*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 50 см	13,0 мл длина 20 см	1

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных уретральных дилататоров

НОМЕР 342100 / 342101 / 342102	
0,035 дюйма	0,89 мм

** Эти изделия содержат натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.*

11.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	БАЛЛОН	КОЛ-ВО
		ДВУХПРОСВЕТНЫЙ Набор гидравлического мочеточникового дилататора для коаксиальной установки, полый внутренний мандрен и двухходовый кран с переходником Luer-lock, входящая в комплект удлинительная трубка из ПВХ,прозрачная, с переходниками Luer-lock (с внутренним и наружным конусом), длиной прибл. 50 см				
конический, открытого типа	342002*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 8:18	прибл. 70 см	3,0 мл длина 9,5 см	1
		ОДНОПРОСВЕТНЫЙ Набор гидравлического мочеточникового дилататора, для применения через уретероскопы				
изогнутый наконечник в форме оливы	342000*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 5:12	прибл. 75 см	0,9 мл длина 5 см	1
			Ch. 6:14			
	342001*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 5:14	прибл. 70 см	0,3 мл длина 2 см	1

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых дилататоров

НОМЕР 342002	
0,035 дюйма	0,89 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

Мягкая баллонная дилатация мочеточника


- дилататоры, изготовленные из полиуретана со специальным армированным баллоном из латекса
- белый, рентгенконтрастный
- градуировка в см
- мандрен
- обратный клапан с двухходовым краном с переходником Luer-lock
- входящий в набор одноразовый шприц
- стерильный, для однократного применения

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

11.4 МЕХАНИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ
для поэтапной дилатации мочеточника

- дилататоры, изготовленные из полиуретана
- высоко-рентгенконтрастный
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

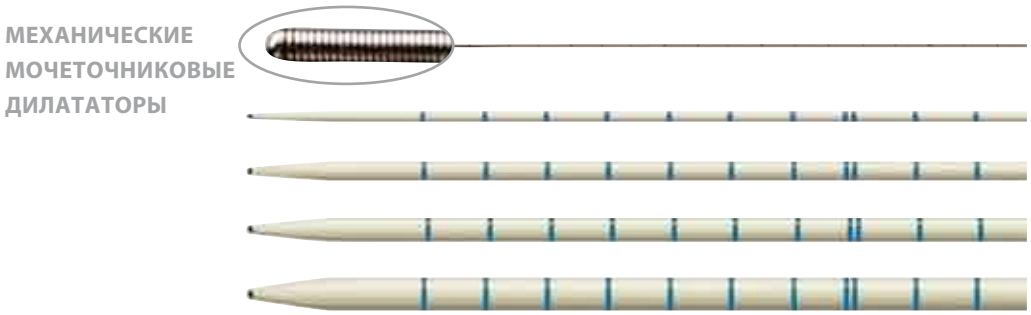

КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
конический, открытого типа гибкий наконечник	341000	**Набор мочеточникового дилататора, модель Vienna состоит** из дилататоров 9 разных размеров и струны-проводника с прямым гибким безопасным наконечником и сантиметровой градуировкой на протяжении 50 см			1
		Дилататоры из полиуретана Струна-проводник из нержавеющей стали	Ch. 6/8-14/16 Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 60 см прибл. 150 см	
конический, открытого типа	341001	**Мочеточниковый дилататор в индивидуальной упаковке**			5
		полиуретан	Ch. 6/8-14/16	прибл. 60 см	
гибкий наконечник	341002	**Струна-проводник в индивидуальной упаковке прямой гибкий** безопасный наконечник, сантиметровая градуировка до 50 см			2
		нержавеющая сталь	Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 150 см	

11

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ ПО КАТАЛОГУ

НОМЕР	СТР.
170003	12
170004	12
170505	14
170605	3
170606	22
170630	6
170702	23/24
170703	22/24
170704	22/24
170717	22/24
170718	22/24
170722	23/24
170723	23/24
170727	22/24
170729	22/24
171100	26
171305	3
171505	3
172530	6
173230	8
173330	8
173420	14
173430	8
173705	15
173800	9
173810	8
173830	8
173900	9
173910	8
173930	8
174000	9
174030	8
174100	9
174130	8
178000	3
178001	3
178003	12
178004	12
178305	3
179000	55
179005	55
179312	13
179313	13
179314	13

НОМЕР	СТР.
179316	13
179360	13/14
179800	54
180003	12
180105	4
180605	4
180630	7
181305	4
181330	7
183230	10
183405	10
183430	10
183530	7
183830	11
183930	11
183960	11
184110	11
186005	4
186505	4
187500	20
187501	16
187502	16
201661	5
201665	7
202201	7
202600	7
204401	11
204410	11
204500	11
204501	16
204502	11
220005	17
220006	17
220500	18
221500	18
221800	18
221900	18
223600	33
223602	33
223604	33
223606	33
223706	33
238000	17
238300	17

НОМЕР	СТР.
238500	18
250100	17
251500	17
252000	17
252600	62
254800	17
259700	17
263602	33
263624	32/34/38
263702	33
263802	33
264001	34
264100	34
264102	34
264200	34
264201	37
264500	35
264600	33
264701	32
264702	32
264710	32
264711	32
264801	32
264810	32
264811	32
267500	35
270300	63
277100	62
310000	47
310001	47
324200	35
331305	5
331505	13
333464	15
333601	33
334200	43
334201	43
334202	43
334205	43
334206	43
334207	45
334208	46
334209	46
334210	46

НОМЕР	СТР.
334211	43
334212	43
334213	43
334231	45
334232	45
334245	45
334246	40
334247	40
334248	40
334249	40
334250	40
334263	45
334400	46
334479	46
334700	45
334702	43
334703	43
334704	45
334705	45
334706	45
334710	43
334711	43
334714	43
334740	40
334741	40
334742	40
334743	40
334744	40
334745	40
334746	40
334751	40
334752	40
334753	40
334760	45
334800	42
334801	42
334802	42
334811	42
334812	42
334840	39
334841	39
334846	39
334900	42
334901	42

НОМЕР	СТР.
334902	42
334940	39
334941	39
335100	42
335101	42
335102	42
335111	42
335112	42
335140	39
335141	39
335142	39
335143	39
335166	42
335200	42
335201	42
335300	42
335301	42
335302	42
335303	44
335304	44
335305	44
335306	44
335307	44
335309	44
335310	44
335311	42
335312	42
335312	44
335313	44
335314	44
335315	44
335316	44
335340	39
335341	39
335400	42
335401	42
335403	44
335404	44
335405	44
335406	44
335407	44
335411	42
335413	44
335414	44

НОМЕР	СТР.
335415	44
335416	44
335417	44
335440	39
335441	39
335524	41
335526	41
335528	41
335620	41
335622	41
335624	41
335626	41
335628	41
340002	51
340003	51
340012	48
340013	48
340014	49
340057	51
340200	53
340201	53
340300	55
340408	54
340409	54
340500	54
340502	54
340700	36
340702	38
340703	38
340800	36
340802	36
340900	53
340901	53
341000	66
341001	66
341002	37/66
341100	53
341200	50
341400	58
341401	58
341402	58
341450	58
341500	58
341501	58

НОМЕР	СТР.
341502	58
341600	58
341601	58
341602	58
341700	58
341730	57/58
341760	58
342000	65
342001	65
342002	65
342100	64
342101	64
342102	64
342200	64
342201	64
342202	64
342700	57
342800	57
342900	57
343030	57/58
345500	15
395751	59
395752	60
395753	61
395763	61
395766	59
395767	59
402100	19
402101	19
403300	19
403900	19
404300	19/56
410200	19
410201	19
415100	19
415600	19
415700	19
526100	38
546000	16
546464	25
546466	25
546476	49
547200	38
547201	38

НОМЕР	СТР.
548000	16
548500	16
556000	16
650704	25
660610	4
660630	6
661610	4
661630	6
662430	6
662530	6
662575	6
662630	6
662675	6
663230	10
663630	6
664130	10
664176	10
664230	10
664275	10
664330	10
664530	10
664575	10
673044	27
673045	30
673049	27
673052	27
673053	29
673054	29
673064	28
673065	28
680141	52
680143	52
680145	52
680151	52
680153	52
680155	52
680160	37
850550	16/22

Восемь способов извлечения катетера Фолея, если не удается опорожнить его баллон.

Д-р Стефан Рот и проф. Л. Хертле, отделение урологии, Университет Мюнстера/Германия


ОПОРОЖНЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ

Техника: Выполните аспирацию, слегка потягивая за конец катетера с попеременным вращением влево-вправо для уменьшения слипания и устранения неровностей в заполняющем просвете.




УКОРОЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА

Техника: Срежьте воронку катетера, поскольку она чаще всего подвергается повреждениям из-за постоянного натяжения и перегибов. В целях безопасности важно сохранить как минимум 5 см катетера от наружного отверстия мочеиспускательного канала.

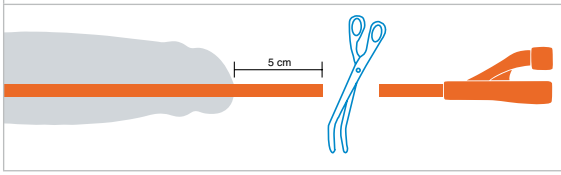


ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ПЕРФОРАЦИЯ

Техника: Зондируйте просвет заполнения тонким зондом (мандреном мочеточникового, центрального венозного или ангиографического катетера). В случае неудачи попробуйте перфорировать баллон введенным мандреном (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).

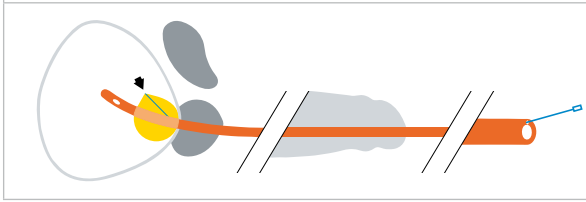


ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИЯ

Техника: Выполнение возможно под контролем рентгенологического (цистография) или ультразвукового исследования. Во время пункции фиксируйте баллон к шейке мочевого пузыря, слегка потягивая за дистальный конец катетера. Для пункции можно использовать иглы для биопсии, нефростомии или спинномозговой пункции (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).

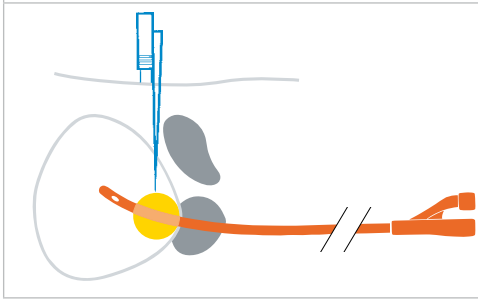

СПОСОБ ГАРПУНА

Техника: Заполните тубус цистоскопа лубрикантом и проведите его по срезанному концу катетера до баллона.
Затем введите зонд между тубусом и катетером, используя способ О'Флинна. В качестве зонда можно воспользоваться толкателями или струнами-проводниками уретральных катетеров (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).

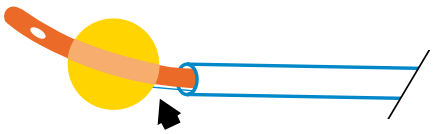


ТРАНСРЕКТАЛЬНАЯ ИЛИ ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

Техника: С помощью гибкой иглы для биопсии пунктируйте баллон, зафиксированный у шейки мочевого пузыря с помощью легкого потягивания за катетер (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).




РАЗРЫВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЯ

Техника: Разрыва можно добиться перерастяжением баллона 0,9 % раствором NaCl. В зависимости от катетера, может понадобиться от 70 до 200 мл раствора. Поэтому это сопряжено с риском разрыва мочевыводящих путей у пациентов с нефростомическими катетерами и сокращенным мочевым пузырем.

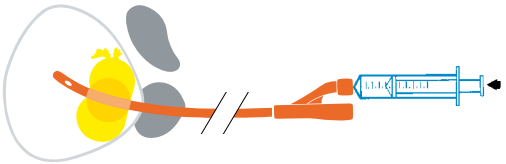

ХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЙ РАЗРЫВ

Техника: Введите через просвет заполнения 10 мл парафина.
При необходимости введите еще 5-10 мл спустя 5-10 мин. В качестве предупредительной меры важно предварительно ввести в мочевой пузырь 100-200 мл физраствора. После извлечения баллонного катетера выполните цистоскопию на предмет обнаружения его фрагментов во избежание их обызвествления.

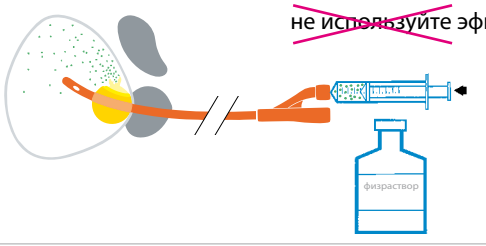

Внимание! Вследствие низкой температуры кипения эфира (34,5 °C), после введения 2-5 мл эфира происходит практически мгновенное увеличение объема до 0,4-1,01 л. Это может стать причиной разрыва мочевого пузыря, особенно у детей. Поэтому применения эфира следует избегать.

Teleflex является ведущим поставщиком изделий медицинского назначения для диагностики и интенсивной терапии критических состояний, а также хирургии. Наша миссия – предоставлять медицинскому персоналу решения, позволяющие добиться лучших результатов и обеспечивающие безопасность пациента и врача. Мы специализируемся на изделиях для общей и региональной анестезии, кардиологии, респираторной терапии, урологии, сосудистого доступа и хирургии. Мы помогаем медикам более чем в 130 странах мира. Teleflex также поставляет комплектующие для производства медицинского оборудования.

К нашим всемирно известным брендам относятся: ARROW®, BEERE MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR EVAC® RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ и WECK®. Все они являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками компании **Teleflex Incorporated.**

Глобальное присутствие Teleflex охватывает такие страны, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Чешская Республика, Франция, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания, Уругвай и США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ (EMEA):

ШТАБ – КВАРТИРА TELEFLEX в EMEA, ИРЛАНДИЯ
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
Телефон+353 (0)9 06 46 08 00 · Факс+353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.teleflex.com

MMG
Medical Marketing Group, LLC

Продукты, перечисленные в этом каталоге, поставляются только в регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Для получения дальнейшей информации обратитесь в ваше местное представительство. Все данные являются актуальными на момент печати(06/2012). Технические изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

94 05 14 - 00 00 RU · REV C · M C/WM · 06 12 01

Teleflex